

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL

PROCESSO/ANO: 12231 - 2019



Página 1 de 1


DADOS CADASTRAIS:

REQUERENTE: SEC. MUN. DE SAÚDE
ENDEREÇO: CONVERSÃO DO SISTEMA Nº S/N, JAGUARIAIVA
TELEFONE: CELULAR:
EMAIL:
CPF/CNPJ: -


DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO
ENTRADA: PROTOCOLO GERAL
USUÁRIO: SABRINA DA SILVA OLIVEIRA
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 17/10/2019 11:14:32
SÚMULA: OFÍCIO 1080/FINAN/SEMUS/ SOLICITA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMCL.

DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Responsável pelo Processo



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE



Of. 1080 /FINAN / SEMUS

Jaguariaíva, 16 de outubro de 2019

Ilmo Sr

Vimos solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Carolina Lupion.


O recurso destinado para a aquisição é referente ao saldo remanescente das Propostas 10952292000/1170-05 e 10952292000/1150-01 cadastradas no FNS para aquisição de equipamentos e material permanente.

| |
|--|
| PROJ / ATIV 2.075 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNIC CAROLINA LUPION |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| FONTE 4.4.90.52.00.00.00.00.0518 / 4.4.90.52.00.00.00.00.0341 |


Seguem anexo o termo de referência e os orçamentos.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas

Atenciosamente,


IONE AP. MENDES DO PRADO
Compras - SEMUS



AMALIA CRISTINA ALVES
Secretária Municipal de Saúde


GUILHERME WASILEWSKI
Diretor Financeiro - SEMUS

ILMO SR
MAURICIO FERNANDES
DIRETOR DPTO COMPRAS E LICITAÇÕES



SECRETARIA DE SAÚDE
RUA ROCHA POMBO ESQUINA COM RUA JOÃO
PERNETA, 101 - CIDADE ALTA
SEMUS - (43) 3535 - 2122




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

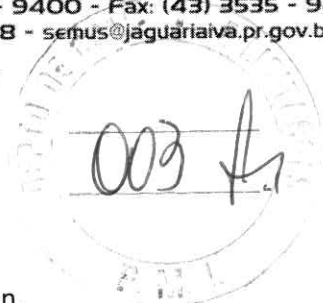


- 1) **OBJETO** : Equipamentos para uso do Hospital Municipal Carolina Lupion.
- 2) **DA JUSTIFICATIVA** : Atender as necessidades do Hospital Municipal.
 - a) **DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA** : Os equipamentos são necessários para a manutenção dos serviços no Hospital Municipal
- 3) **DO VALOR ESTIMADO** :
- 4) **DO DETALHAMENTO , DAS ESPECIFICAÇÕES , QUANTIDADES E ESTIMATIVAS DE PREÇOS** :

| ITEM | DESCRIÇÃO / APRESENTAÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------|---------|----------------|-------------|
| 1 | Anexo I | Anexo I | | |

- 5) **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** : A empresa deverá apresentar as licenças , registros e autorizações para a comercialização dos materiais e atender as exigências contidas no Anexo II
- 6) **DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA** :
- 7) **DO FRETE** : Por conta da empresa vendedora
- 8) **DAS AMOSTRAS** : Será solicitado amostra
- 9) **DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA** : 10 dias após o envio da SF
- 10) **LOCAL DE ENTREGA** : Hospital Municipal Carolina Lupion .
- 11) **DO FISCAL DE CONTRATO E FISCAL TÉCNICO** : O fiscal do contrato será o Sr Guilherme Wasilewski Diretor Financeiro da SEMUS

CPF : 838.284.359-04





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE


RG : 5.526.028-1

A fiscalização técnica ficará a cargo da Enfermeira Mariana Carneiro

RG : 9.286.269-0

CPF: 061.131.669-29

Jaguariaíva , 16 de outubro de 2019.


Ione Ap. Mendes do Prado
Resp. Compras - SEMUS



SECRETARIA DE SAÚDE


RUA ROCHA POMBO ESQUINA COM RUA JOÃO
PERNETA, 101 - CIDADE ALTA
SEMUS - (43) 3535 - 2122



ANEXO I

DESCRITIVOS

| | DESCRITIVO | Quantidade |
|----|---|------------|
| 01 | <p>APRESENTAR AMOSTRAS DOS PRODUTOS; EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA TODOS OS PRODUTOS: A empresa vencedora se obriga a fornecer os bens de acordo com as especificações, constante de sua proposta, obedecendo rigorosamente, o prazo de entrega de até 30 dias . A entrega é de responsabilidade da empresa. Os itens que necessitam de instalação e treinamento devem ser fornecidos pela empresa vendedora.</p> <p>INALADOR HOSPITALAR DE 4 SAÍDAS Compressor utilizado para produção de ar comprimido, deverá ser isento de óleo ou impurezas. Equipamento com registro na ANVISA, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 : 2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2 : 2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6 : 2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9 : 2010 Marcação CE (Comunidade Européia) Possuir a seguintes informações: *</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensão de alimentação: 127 ou 220Vac; • Cabo de alimentação com plug de 3 pinos (com pino de aterramento); • Frequência de rede: 50 ou 60 Hz; • Potência do motor: 1/4 de CV; • Interruptor liga / desliga, localizado no corpo do aparelho; • Sistema de proteção, com rearme automático, para super aquecimento do motor; • Sistema de exaustão forçada de ar do motor. • Fluxo de ar: 0 a 70 Litros/minuto • Compressão máxima: 40 lbf/pol² • Carenagem Plástica de alta resistência. • Base: pés antiderrapantes de borracha com sistema de ventosas. <p>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Dimensões Externas (Sem Suporte) Largura 18,6 cm Altura 28,6 cm</p> | 04 |

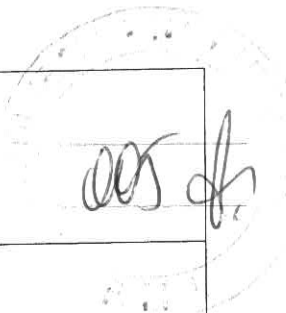


| | | |
|----|---|----|
| | <p>Comprimento 21,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso líquido: 5.4 Kg <p>ACOMPANHAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 Conjuntos micronebulizador com máscara senso 04 unidades adulto e 04 unidades infantil, extensão e copinho para medicamentos • Régua com quatro saídas com válvulas. • Micro filtro | |
| 02 | <p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO</p> <p>Foco Cirúrgico Teto Simples. Deverá ser composto por uma cúpula com sistema de iluminação na tecnologia LED. A estrutura dos braços, base, eixo, garfo e antebraço deverão ser em aço, com pintura epóxi. A cúpula de vera possui formato circular, ser simétrica e fabricada em Fibra de Vidro antichama e gel-coat ou outro polímero de mesma resistência.</p> <p>A cúpula principal deverá possuir: potência luminosa aproximada de 160.000 Lux (+/-2%); diâmetro Máximo da cúpula de 595 mm; quantidade mínima de 4 (Quatro) bulbos/placas de LED/ conjuntos de LEDs brancos; e a quantidade mínima de 82 (oitenta e dois) LEDs na sua composição.</p> <p>A potência luminosa total aproximada do equipamento deverá ser de: 160.000 Lux (+/-2%) aferido a 1 (um) metro e distância da cúpula. Índice de reprodução de cor (RA): 95 ±3. Com sistema de focalização mecânico tipo multifocal.</p> <p>A Temperatura de Cor Fixa deverá ser fixa em 5.000 Kelvin (+/-2%). A iluminação gerada pelos LEDs deverá ser fixa sem variação da temperatura de cor, possuindo apenas LEDs brancos na sua constituição, proporcionando maior estabilidade cromática do local iluminado; A vida útil estimada dos LEDs deverá ser de pelo menos 75.000 horas.</p> <p>A cúpula de vera possui ajuste manual do campo luminoso através da manopla de focalização em alumínio localizada no centro da cúpulas, a qual de vera ser removíveis sem o uso de ferramentas e Autoclaváveis. O diâmetro do campo luminoso mínimo oferecido por cada da cúpula de vera ser de pelo menos 100 mm (+/-2%) e o diâmetro Máximo oferecido de vera ser de pelo menos 355 mm (+/-2%).</p> <p>A cúpula de vera possui sistema de iluminação especial para cirurgias minimamente invasivas, também chamado de Modo Endo ou Luz Ambiente, o qual de vera estar localizado no centro de da cúpula. O sistema de vera ter acionamento individualizado no painel de comando do equipamento.</p> <p>O foco cirúrgico de vera possuir os seus comandos, através de painel de membrana, individual por cúpula, sendo eles: Liga/Desliga, Modo Endo e Dimmer (com pelo menos 9 níveis de intensidade de potência luminosa, o qual de vera proporcionar o ajuste da intensidade luminosa de 10% a 100% potência da Cúpula). Os comandos de vera estar localizados na própria estrutura do foco cirúrgico, sem a necessidade de instalação de comandos e controles acessórios na parede do centro cirúrgico. O(s) painel(is) de comando de vera(ão) estar protegidos por painel de membrana de fácil higienização</p> <p>O Foco Cirúrgico de vera proporcionar coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula; Tensão (v): 110 v-220V; Frequência (Hz): 50hz/60hz. Os bulbos de vera estar isolados dentro da cúpula, com proteção em acrílico. Os braços de vera apresentar</p> | 01 |

| | | |
|----|--|----|
| | <p>movimentação leve e precisa, sem o uso de contrapesos.</p> <p>O sistema de alimentação através de fonte chaveada, garantindo maior estabilidade ao funcionamento do equipamento.</p> <p>Informações complementares: Equipamento enquadrado às Normas Técnicas NBR IEC 60.601-1/1994 + Emenda 01/1997 e NBR IEC 60.601-1-2. Empresa Certificada de acordo com a NBR. Deverá possuir assistência técnica no Estado..... O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde; Garantia de 12 (meses) contra defeitos de fabricação. No valor apresentado deverá estar contemplado o frete, instalação e o treinamento da equipe de usuários do equipamento.</p> | |
| 03 | <p>CARRINHO DE EMERGÊNCIA</p> <p>Confeccionado em estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1.20mm e tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – 430AISI</p> <p>Acompanhar os seguintes: 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisórias em acrílico; Sistema de lacre único para as 04 gavetas; Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador; Suporte para cilindro de O2; Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de 800mm de comprimento; Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T); Tábua para massagem cardíaca em madeira MDF; Chassi com proteção de borracha em toda a volta; Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal Possuir acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensão aproximada de 700 x 500 x 800 mm e registro MS</p> | 05 |
| 04 | <p>CARRO CONTAINER EM FIBERGLASS COM TAMPA - 630 LITROS</p> <p>Modelo idealizado visando melhor ergonomia no transporte de materiais que requerem maior esforço do operador;</p> <p>O Carro deve possuir Porta Lateral e Sistema de Freios é confeccionado em fiberglass de alta durabilidade e resistência, com acabamento em gel coat isoftálico, liso interna e externamente. Possui dreno para escoamento de líquidos. Dispositivo de elevação e suporte da tampa, por sistema pneumático que reduz o impacto da tampa superior e proporciona leveza na sua abertura. Modelo com tampa. Possibilita fácil higienização.</p> <p>Pneus: maciços, diâmetro 06", que apresentam boa absorção de choques e eliminação de ruídos, ou seja, a mesma performance dos infláveis: leves, silenciosos e macios, sem a necessidade de enchê-los. Banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado.</p> <p>Sistema de Freios para o Condutor: composto de sistema manual de freios, o qual permite melhor controle do carro em rampas de descida, com duplo acionamento acoplados no puxador, que é confeccionado em aço inoxidável.</p> <p>Com sistema de proteção anti-impactos laterais e frontais.</p> | 02 |
| 05 | <p>BANQUETA HOSPITALAR</p> <p>Confeccionado em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304</p> <p>Possuir assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura - AISI430, assento com 350mm de diâmetro, arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304, altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado e 04 pés com ponteiros plásticos. Dimensão de 350 mm - Altura Máxima de 700 mm e capacidade de até 110Kg</p> | 04 |



| | | |
|----|---|-----|
| 06 | ARMÁRIO DE CABECEIRA DE CAMA Confeccionado em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura, tampo de refeição em tubo de aço cromado e acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso Acompanhar tampo da mesa e de refeição em MDF c/ revestimento em laminado decorativo Possuir 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço; Tampo de refeição com regulagem de altura; Puxadores em material de aço carbono; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Dimensão de: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima de 1230 mm | 50 |
| 07 | Monitor Multiparametro Descrição: Deve fornecer dados vitais do paciente de forma precisa, rápida e fácil de analisar, com excelente visibilidade das informações e flexibilidade de parâmetros, alças de transporte. ECG - Respiração - Oximetria - Pressão Não Invasiva - 2 Temp - 2 Pl, Módulo de Capnografia/Main/SideStream, tela TFT LCD colorida de alta resolução de 7" a 9", análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso, bateria de lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade, memória interna para 128 horas de armazenamento de dados, pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos, alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis, conexão com central monitorização via cabo ou wireless, alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme, suporte para fixação em macas integrado na alça, congelamento de imagem e cálculo de drogas. Marca similar ou superior: BM5 Bionet (01-24-1645) | 02 |
| 08 | Telefone Com Fio - Preto Resistente, prático e fácil limpeza. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar), pode ser instalado na parede, possui fio longo para comunicação. | 100 |

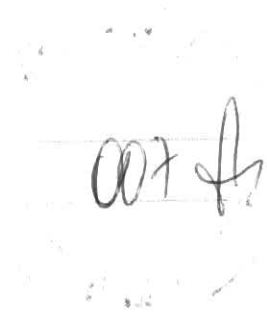

ANEXO II

ORÇAMENTOS

| Orçamento de Produtos | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| Produtos | Orçamento 01 | Orçamento 02 | Orçamento 03 | Orçamento 04 | Orçamento 05 |
| Inalador Hospitalar De 4 Saídas | HD Hospitalar Distribuidora R\$ 2.020,00 | Marca Médica R\$ 1.294,85 | COMPRESSOR DE NEBULIZAÇÃO MOD C-71 MARCA OLIDEF R\$ 1.468,50 | NEBULIZADOR INALADOR 4 SAIDAS / MEDICATE R\$ 1.749,90 | Compressor Nebulizador - Nevon - 4004PO R\$ 1.803,00 |
| Foco cirúrgico de teto com Luz de led | FOCO CIRÚRGICO TETO SIMPLES MODELO INP 4 F-MASTER MARCA INPROMED R\$ 17.160,00 | Bem-estar. R\$ 41.860,00 | Grupo kss R\$ 37.800,00 | MARCA INPROMED R\$ 17.160,00 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO FL-2000 T4 E / MEDPEJ R\$ 19.216,00 |
| Carrinho de emergência | CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO, COM SUPORTE P/ MONITOR E TAMPO EM AÇO INOX MOD RNT1700 MARCA RENASCER R\$ 2.193,30 | CARRO DE EMERGENCIA / ECAFIX R\$ 2.879,50 | CARRO DE EMERGENCIA CP1000 MEDCLEAN R\$ 2.798,00 | Clinrio Produtos Médicos R\$ 4.400,00 | Med Clean R\$ 5.749,00 |
| CARRO CONTAINER EM FIBERGLASS COM TAMPA - 630 LITROS PNEUS MACIÇOS 06 | Inova distribuição R\$ 1.526,18 | Carrinhos Brasil R\$ 1.604,25 | CONTAINER DE 1000 LITROS SEM R\$ 1.673,60 | CONTÊINER C100 INOVA R\$ 1.809,20 | V S COSTA E CIA LTDA R\$ 475,80 |
| Baqueta Hospitalar | Dormed Hospitalar R\$ 684,00 | Med Clean R\$ 395,25 | MOCHO GIRATORIO INOX, ASSENTO INOX, SEM RODÍZIOS MOD RN09005 MARCA RENASCER R\$ 360,15 | MOCHO BANCO GIRATÓRIO ALTURA REGULÁVEL TOTALMENTE INOX COM RODÍZIOS MEDCLEAN R\$ 489,50 | MOCHO GIRATÓRIO INOX – GIAMED R\$ 470,65 |
| Armário de cabeceira de cama | Hospinet Comércio e Assistência Técnica R\$ 838,72 | Medaxo Distribuidora R\$ 850,00 | MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA MOD RN07027 MARCA RENASCER R\$ 950,20 | MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA MEDCLEAN R\$ 1.249,80 | V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83 R\$ 1.138,15 |
| Monitor Multiparametro | CARDIOVERSOR MOD VIVO BASICO MARCA CMOS DRAKE R\$ 18.546,60 | MONITOR CARDIOVERSOR BIFÁSICO CARDIOMAX INSTRAMED R\$ 18.546,60 | MONITOR CARDÍACO MX-100 – EMAI R\$ 19.100,00 | Produtos Hospitalares Online R\$ 9.800,00 | DORMED HOSPITALAR EIRELI R\$ 7.699,75 |
| Aparelho Telefônico | Telefone com fio Intelbras Pleno com chave - Angeloni R\$ 32,90 | Telefone de mesa grafite K103 Keo - Kalunga R\$ 32,90 | Telefone Intelbras Pleno 4080055 - Gazin R\$ 35,90 | Telefone com fio Intelbras icon 4080051 pleno preto - Track Info R\$ 39,57 | |

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83


PREF. DE JAGUARIAIVA PARANA

Proposta número 150/2019

Grato por ter entrado em contato, segue abaixo a nossa cotação para a Vsa. apreciação, qualquer dúvida favor entrar em contato.

ORÇAMENTO

| | | | | |
|----|-----|---|------------|--------------|
| 04 | UNI | Compressor Nebulizador - Nevoni - 4004PO | VALOR UNIT | R\$ 1.803,00 |
| | | Inalador Multi Nebulizador Inalatron - Nevoni - 4004PO Bivolt Indispensável para aplicação de medicamentos nas áreas respiratórias, promovendo com eficiência a nebulização simultânea de medicamentos para até 4 pacientes. Projetado para emitir névoa, ou seja, para transformar o medicamento ou soro fisiológico em pequenas partículas, que poderão ser inaladas e assim, chegar mais facilmente às vias respiratórias, aliviando e desobstruindo a respiração. Prático e eficiente. Cúpula em material super resistente. Recomendado em clínicas e hospitais. Acessórios: • 04 Conjuntos de Nebulizadores em saco plástico contendo: Tubo átoxico e copo dosador • 08 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (04 Adulto e 04 Infantil) • 01 Folheto com manual de Instruções Especificações Técnicas: • Compressão: Pistão oscilante • Compressor: 80 libras (máxima) • Consumo de energia: 341 Watts • Nebulizadores: 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente • Terminais de saída: Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento dos demais • Voltagem: 110 e 220 volts (60 Hz) automático. | | |



| | | | | |
|----|-----|---|------------|---------------|
| 05 | UNI | PERFURADOR ÓSSEO TAIMIN | VALOR UNIT | R\$ 20.544,10 |
| | | O Perfurador Ósseo canulado da Taimin foi desenvolvido para atender procedimentos cirúrgicos na realização de orifícios no tecido ósseo, inserção e remoção de pinos e fios, e no preparo de cavidades ósseo-cartilaginosa esféricas. Voltagem da fonte elétrica do carregador: AC 100 ~ 220V/60HZ Portátil à bateria Velocidade: 0-1000 r.p.m. Velocidade controlada Sentido de rotação normal e reversível Torque: 0.75 -1.12N/m Ruído: ≤70db Peso: 1.230g Bateria não autoclavável Anvisa: 80082910112 | | |

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

* TRADIÇÃO

Rua Francelho, 69- Centro - Fone/Fax: (43) 3245-6600 - CEP 86706-000 - Arapongas-
Paraná


CNPJ 05.286.960/0001.83 - ICMS 903.64620-91

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83



- 01 UNI **FOCO CIRÚRGICO TETO 1 CÚPULA 4 BULBOS M300T 4B MARTEC** VALOR UNIT R\$ 18.655,20
- Foco Cirúrgico Teto 1 Cúpula 4 Bulbos M300T 4B - Martec O Foco Auxiliar Cirúrgico Martec é um equipamento de grande utilidade para a equipe médica, projetado e fabricado pela Martec com toda a qualidade, segurança e eficácia necessária ao auxílio à vida. Trata-se de um equipamento que auxilia a equipe médica durante as intervenções cirúrgicas, os procedimentos clínicos e ambulatoriais, pois ilumina o campo sob visualização através de lâmpadas que direcionam o foco de luz para a área desejada. O Informações do Equipamento Cúpulas plásticas de alta resistência com 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6, 6x6 bulbos de lâmpadas Halógena. Com 1 ou 2 cúpulas. Braços articulados que permitem a mobilidade dos cabeçotes em diversas direções; Chave liga-desliga; Transformador; Pintura eletrostática em epóxi; Cabo de alimentação da rede de energia elétrica; Refletor dicróico que permite a redução de calor e melhor dispersão da luz com filtro antitérmico e linhas multifacetadas; Suporte para fixação no teto. Opcionais: DETALHES TÉCNICOS Frequência de rede de alimentação: 60 Hz Tensão: 127/220V Número de fases: Bifásico Lâmpada halógena: 12 v - 55W

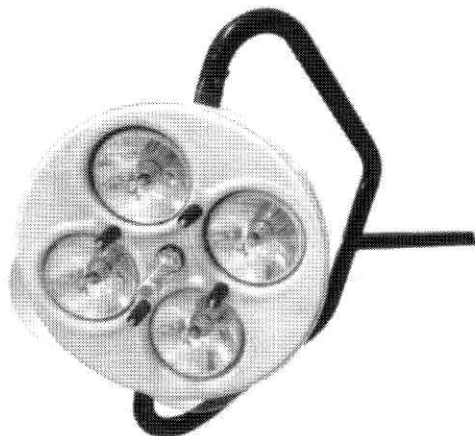

- 05 UNI **CARRO DE EMERGÊNCIA CP1000 MEDCLEAN** VALOR UNIT R\$ 2.798,00
- Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos. Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral. Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos. Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+ T) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.
- Acompanha: Suporte para soro com altura ajustável, Tábua para massagem cardíaca em acrílico, suporte para cilindro de oxigênio e Trava para gavetas / basculante.
- Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm, peso: 63 Kg. Fabricação Nacional.



- 01 UNI **CARRO TÉRMICO DETRIX** VALOR UNIT R\$ 73.500,75
- Carro térmico para transportar bandejas com alimentos Refrigerados e Aquecidos, fabricado em aço inox com 2 portas com puxadores e travas, gaxetas magnéticas e com

*CONFIABILIDADE
* TRADIÇÃO

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

Rua Francelho, 69- Centro - Fone/Fax: (43) 3245-6600 - CEP 86706-000 - Arapongas-
Paraná

CNPJ 05.286.960/0001.83 - ICMS 903.64620-91

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83

controle de temperatura digital: Lado quente, aquecido por resistências elétricas blindadas, para transportar alimentos em temperatura controlada de até 90°C; Lado frio, refrigerado por meio de parede fria com serpentina, para transportar alimentos em temperatura controlada de até 5°C; Utilizado como carro térmico hospitalar e como carro térmico em hotéis e indústrias de refeições coletivas para transportar alimentos preparados em temperaturas controlada; Rodízios Ø 8" com freio; Para choques de borracha para mover em corredores e elevadores: 220 v monofásico; Potência 2 kw; Preço de carro térmico direto da fábrica.

Dimensões: 1235 x 720 x 1405 mm.

Lado Aquecido: Temperatura de 80°C a 90°C.

Lado Refrigerado: Temperatura de 0°C a 5°C.


Tempo de conservação após desligado 20 minutos.

Guias reguláveis para cubas GN, bandejas e grades.

*GN 1/1x100 mm (14 unidades não inclusas).

*Bandeja 475x327x23 mm (16 unidade não inclusas).

*Grade 540x340 mm (16 unidades não inclusas).

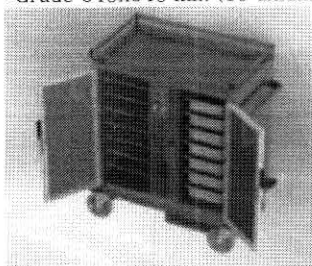

04 UNI CONTÊNER PLÁSTICO, 1000 LITROS – PLAST

VALOR UNIT R\$ 1.888,80

Lixeira/Contêiner/Contentor rotomoldado, com tampa, fabricado em polietileno (PEMD) utilizando material reciclável (produto sustentável). Capacidade volumétrica de 1000 Litros. Produto basculável. Contém aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM – American Society for Testing and Materials).

VANTAGENS

- Não oxida
- Proteção raios UV
- Facilidade de Limpeza, mais higiênico
- Produto leve
- Munhões em aço (maior resistência mecânica)

DESCRIÇÃO

Lixeira/Contêiner/Contentor fabricado através de processo de rotomoldagem, em polietileno de média densidade (PEMD), utilizando material reciclável (produto sustentável), com capacidade volumétrica de 1000 Litros ou 400 Kg. Contém um aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM – American Society for Testing and Materials). Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm, feitos de borracha maciça com núcleo de polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana e dreno para escoamento de líquidos.

-Medidas: 130 x 107 x 129 cm (CxLxA)

-Peso: 49 Kg

-Capacidade de carga: 400 kg

-Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 8 e 2 rodízios giratórios de 8 de borracha (redução de impacto e freio de estacionamento)

-Material: Polietileno de material reciclado de média densidade (PEMD)

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE


* TRADIÇÃO

Rua Francelho, 69– Centro – Fone/Fax: (43) 3245-6600 – CEP 86706-000 – Arapongas– Paraná

CNPJ 05.286.960/0001.83 – ICMS 903.64620-91

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83



01 UNI PINÇA DEORDENHA GOLGRAN

VALOR UNIT R\$ 475,80

03 UNI MONITOR CARDÍACO MX-100 – EMAI

VALOR UNIT R\$ 19.100,00

ECG

O novo Monitor Cardíaco EMAI mod. MX-100 apresenta as últimas inovações na área cardiológica. Com tecnologia digital e poderoso microcontrolador que fornecem parâmetros, sinais e registros de alta qualidade e resolução, proporciona a melhor relação custo/benefício do mercado. Ganho manual e automático - 0,25;0,5;1;2 mV/cm Detecção da onda "R" por software inteligente

Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo

Cabo paciente de 3 e 5 vias Derivações: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF e V (5 vias) DI, DII, DIII (3 vias)

Permite a interligação com desfibrilador Operação no modo Filtro e Diagnóstico Faixa de medição: 30 a 300 BPM

Limites de alarmes: 16 a 300 BPM em passo de 1 BPM

Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior)

Retorno após desfibrilação: 5 se

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Congelamento da forma de onda de ECG Monitoração no modo adulto e neonatal

Memória não volátil data, hora Ajuste digital do contraste do display Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes

Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s Ajuda "on-line" na tela Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca,

rede elétrica ou só bateria Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria

Compensação do contraste do display de acordo com a temperatura ambiente Alça para transporte e fixação

ALIMENTAÇÃO

Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz


Adequada a conexão à rede elétrica CISPR11

Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada)

Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática

Padrão: 1,3AH - autonomia mínima de 1 hora

Tempo de Recarga Mínima: 5 horas quando totalmente descarregada (bateria padrão)



05 UNI TERMOMETRO DIGITAL AKSO

VALOR UNIT R\$ 199,99

Faixa de medição:

-10 a 50°C (sensor interno)

-50 a 70°C (sensor externo)

20 a 99%UR

Resolução:

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

* TRADIÇÃO


Rua Francelho, 69- Centro - Fone/Fax: (43) 3245-6600 - CEP 86706-000 - Arapongas-Paraná

CNPJ 05.286.960/0001.83 - ICMS 903.64620-91

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83

0,1°C
1%UR
Exatidão:
±1°C (-10 a 50°C)
±1,5°C (outras faixas)
±5%UR
Comprimento do sensor: 1,5 m (aproximadamente)
Temperatura de operação: -10 a 50°C
Umidade de operação: 20 a 99%UR (sem condensação)
Dimensões: 98 x 106 x 23 mm (LxAxP)
Peso: 140g (com pilhas)
Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA)
Funções adicionais:
- Seleção °C / °F
- Registro de máxima e mínima
- Relógio com Alarme

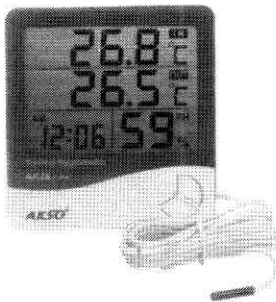


04 UNI **MOCHO GIRATÓRIO INOX – GIAMED**

VALOR UNIT R\$ 470,65

DESCRIÇÃO

- Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304
- Assento inox
- Assento com 300 mm de diâmetro
- Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304
- Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado
- 04 pés com ponteiros plásticos
Altura Mínima 350 mm
Altura Máxima: 700 mm
Dimensão Aproximada : 420 mm x 420mm x 350mm



50 UNI **MESA CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA – CENTERMEDICAL**

VALOR UNIT R\$ 1.138,15

Mesa de cabeceira construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2".
Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt.
Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição: 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0,94 1.14 m de altura.
Embalagem: 0,45 x 0,57 x 1,00.
Cubagem: 0,257 M³.
Peso: 20kg

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

* TRADIÇÃO

Rua Francelho, 69– Centro – Fone/Fax: (43) 3245-6600 – CEP 86706-000 – Arapongas–
Paraná

CNPJ 05.286.960/0001.83 – ICMS 903.64620-91

V. S. COSTA HOSPITALAR

V S COSTA E CIA LTDA CNPJ:05.286.960/0001.83




30 UNI

CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER 3 MANIVELA- LEVITA

VALOR UNIT R\$ 5.879,75

Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito
Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Grades laterais: 1,20X0,40 cm Capacidade máxima: 130 kg
A estrutura da Cama é construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidos regularmente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama que fabricamos. É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. Cabeceiras e Peseiras removíveis produzidas em material termoplástico de alta-resistência. O cliente também pode escolher cores nos detalhes de acabamento das Cabeceiras e Peseiras. Consulte cores disponíveis. Estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe "trava" e "destrava". Nossas camas passam por 8 rígidos processos de fosfatização onde prepara as superfícies metálicas para permitir uma boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão tais como a ferrugem. Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal.

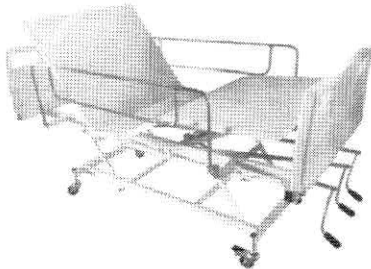

FORMA E PGTO: A VISTA
GARANTIA: 01 ANO
ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE
FRETE: PAGO

SEM MAIS

VS COSTA & CIA LTDA
Marcos Costa

05.286.960/0001.83

V S COSTA & CIA LTDA

Rua Franceiño - 69

86707-040 ARAPONGAS - PR

*CONFIABILIDADE
* TRADIÇÃO

*ENTREGA RÁPIDA


*PRODUTOS DE QUALIDADE

Rua Francelho, 69- Centro - Fone/Fax: (43) 3245-6600 - CEP 86706-000 - Arapongas-Paraná

CNPJ 05.286.960/0001.83 - ICMS 903.64620-91


012

| | |
|--|------------------------|
| A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA AT/ COMPRAS TELEFONE (43) 3535-9400 JAGUARIAIVA - PR | |
| REFERENTE: ORÇAMENTO GG-0024-2019-02 | DATA: 28/08/2019 |
| GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | GARANTIA: 01 ANO |
| PAGAMENTO: A COMBINAR | FRETE: CIF |
| PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS | MARCA: CONFORME ABAIXO |
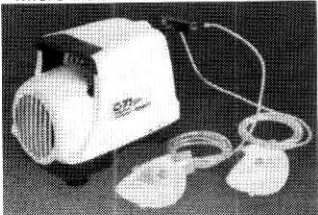
| ITEM | QTD | UNI | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | 04 | UNI | <p>COMPRESSOR DE NEBULIZAÇÃO MOD C-71 MARCA OLIDEF GERAL • Compressor utilizado para produção de ar comprimido, isento de óleo ou impurezas, indicado para nebulização. • Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227180013, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 : 2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2 : 2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6 : 2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9 : 2010 Marcação CE (Comunidade Européia) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Tensão de alimentação: 127 ou 220Vac; • Cabo de alimentação com plug de 3 pinos (com pino de aterramento); • Frequência de rede: 50 ou 60 Hz; • Potência do motor: 1/4 de CV; • Interruptor liga / desliga, localizado no corpo do aparelho; • Sistema de proteção, com rearme automático, para superaquecimento do motor; • Sistema de exaustão forçada de ar do motor. • Fluxo de ar: 0 a 70 Litros/minuto • Compressão máxima: 40 lbf/pol² • Carenagem Plástica de alta resistência. • Base: pés antiderrapantes de borracha com sistema de ventosas. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Dimensões Externas (Sem Suporte) Largura 18,6 cm Altura 28,6 cm Comprimento 21,3 cm • Peso líquido: 5.4 Kg ACOMPANHA • 04 Conjuntos micro nebulizador com máscara 04 uni adulto e 04 uni infantil, extensão e copinho para medicamentos • Régua com quatro saídas com válvulas. • Micro filtro</p>  | R\$ 1.468,50 | R\$ 5.874,00 |
| 2 | 05 | UNI | <p>PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 2000 COM PASSADOR DE FIO MARCA TECNOAR Perfurador ósseo Canulado Pneumático, projetado para uso hospitalar em cirurgias ortopédicas e procedimentos cirúrgicos nos orifícios do tecido ósseo, com utilização de vários tipos de brocas ou trefinas, fresas e raspas de ação giratória para preparo de cavidades ósseo-cartilaginosas esféricas. Podendo ser usado também para introdução e extração de pinos e fios lisos ou com roscas. Possui canulação de 4,5 mm, funciona nos sentidos horário, anti-horário e neutro. Funcionamento com nitrogênio, ar medicinal e ar comprimido, autoclavável a 134º graus. Turbina motora de até 30.000 RPM com acionamento progressivo através de um gatilho no próprio cabo. 01 Mandril rápido em aço inox, com abertura de 0,0 até 6,5mm com chave para aperto de brocas, velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM, 01 Mandril de alto torque com abertura de 0,0 até 10,0 mm para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a 250 RPM, 01 passador de fio com abertura de 0 até 2,5.</p> | R\$ 18.150,00 | R\$ 90.750,00 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda



CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel - PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com
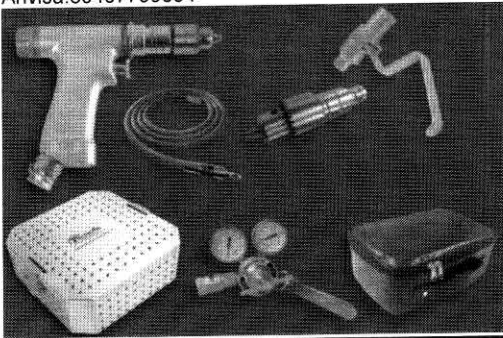
| | | | | |
|---|----|--|---------------|---------------|
| | | <p>Accessórios: Caixa para acomodação e transporte autoclavável; Mangueira de silicone acople rápido, autoclavável 03 metros de comprimento; regulador de pressão com engate rápido e chave para fixação no torpedão com maleta para transporte; Óleo lubrificante 10 ml; Manual e certificado de garantia. Anvisa:80407799004</p>  <p>imagem meramente ilustrativa</p> | | |
| 3 | 01 | <p>UNI FOCO CIRÚRGICO TETO SIMPLES MODELO INP 4 F-MASTER MARCA INPROMED</p> <p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, com sistema de iluminação na Tecnologia Led, sendo seus bulbos/placas LED compostas por lentes colimadoras individualizadas e LEDs individualizados, formando conjuntos de LENS e Lentes Colimadoras Individualizados (cada LED possuirá uma Lente Colimadora). Proporcionando: Luz fria; maior nitidez; sem incidência de sombras, raios UV e raios Infravermelhos.</p> <p>A estrutura dos equipamentos da Linha INP MASTER é composta por cúpula(s) simétrica(s) em fibra de vidro ou poliuretano, com as estruturas do(s) braço(s), garfo(s) e base em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;</p> <p>A Linha de Foco Cirúrgico INP MASTER possui excelente coluna de luminosa permitindo ao usuário grande desempenho na iluminação do Campo Cirúrgico. Sendo indicados para realização de Grandes, Médios e Pequenos procedimentos cirúrgicos;</p> <p>A disposição dos LEDs foi projetada no sistema multifocal, para permitir o melhor desempenho luminoso no campo operatório. Trabalhando com feixes luminosos sobrepostos temos uma melhor coluna luminosa que reduz a incidência de sombras aumentando a qualidade de iluminação do Campo e das Cavidades. Possuindo baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Sendo o sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório.</p> <p>Os equipamentos da Linha Master possuem Ajuste do Diâmetro do Foco, que é realizado através da(s) Manopla(s) Esterilizável (is) em Alumínio localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). O usuário poderá realizar a abertura e fechamento do diâmetro do campo luminoso, melhorando o desempenho do cirurgião nos procedimentos que exijam iluminação de campo e profundidade.</p> <p>Temperatura de Cor: Existem duas possibilidades de composição de LEDs na Linha INP MASTER onde a Temperatura de Cor poderá ser monocromática que é composta apenas por LEDs Brancos, com a temperatura de cor fixa em 5.000 Kelvin (K). E a composição multicromática que é composta por LEDs Brancos e Amarelos, que permite ao usuário o ajuste da Temperatura de Cor entre 3.200K e 5.000 Kelvin (K), proporcionando melhor conforto visual e qualidade na distinção dos tecidos observados.</p> <p>A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas.</p> <p>Iluminação especial para procedimentos de vídeo cirurgias, também conhecida como Modo Endo, está disponível em todos os modelos Linha INP Máster. Sendo indicados para iluminação em procedimentos de vídeo cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva do foco cirúrgico nos monitores da torre de vídeo;</p> <p>O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP MASTER é individual por cúpula e está localizado no braço de sustentação das cúpulas (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base ou braço (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios). O Painel de Comando é protegido por membrana em policarbonato, proporcionando facilidade de limpeza e higienização. Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos, bem como facilitam a instalação dos equipamentos. São os comandos existentes: Regulador de Intensidade Luminosa (Dimmer) que permite o ajuste da potência do equipamento entre 10% a 100% da potência da cúpula; Botão Liga Desliga da Cúpula; Botão do Modo Endo; Ajuste de Temperatura de Cor, para o ajuste da Temperatura de Cor entre 3.200K e 5.000K (exclusivo nos modelos Multicromáticos).</p> <p>As movimentações dos braços e da(s) cúpula(s) são leves e utilizam sistemas de molas e freios. Sendo possível realizar os movimentos estáveis e precisos de:</p> | R\$ 17.160,00 | R\$ 17.160,00 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

013

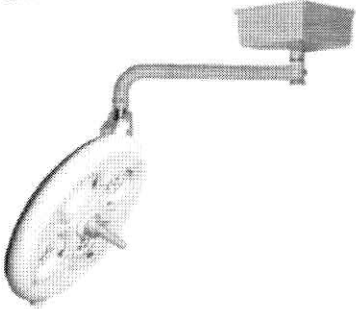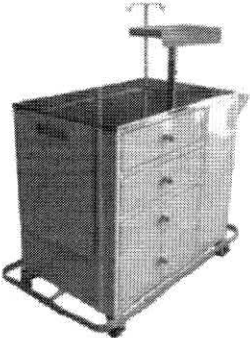

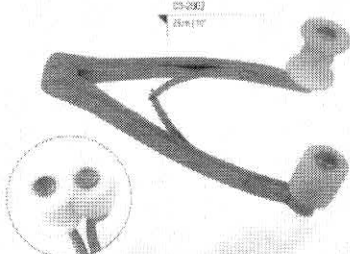
| | | | | |
|---|----|---|---------------|---------------|
| | | <p>torção, flexão, basculante, vertical, horizontal e circular, sem o uso de contrapesos. Índice de Reprodução de Cor (Ra): 95 ±3 Diâmetro do campo (por cúpula): 100-360 mm Profundidade (mm): 1500 mm Diâmetro da cúpula: 587 mm Tensão de Alimentação: 110-127 V / 220-230V Número do Registro Anvisa: 80131170002 Quantidade de LEDs por Equipamento: 84 LEDS Quantidade Total de Lentes Colimadoras: 84 Lentes</p>  | | |
| 4 | 05 | <p>UNI CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO, COM SUPORTE P/ MONITOR E TAMPO EM AÇO INOX MOD RNTI700 MARCA RENASCER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1.20mm - Tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – 430AISI - 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisórias em acrílico - Sistema de lacre único para as 04 gavetas - Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador - Suporte para cilindro de O2 - Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de 800mm de comprimento - Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T) - Tábua para massagem cardíaca em madeira MDF - Chassi com proteção de borracha em toda a volta - Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso <p>Dimensão aproximada: 700 x 500 x 800 mm Registro MS: 80430259005</p>  <p><i>Imagem ilustrativa</i></p> | R\$ 2.193,30 | R\$ 10.966,50 |
| 5 | 01 | <p>UNI CARRO TÉRMICO REFRIGERADO DE TRANSPORTE FECHADO MOD CF203TR MARCA ALBAN</p> <p>Descrição Fabricado em aço inox AISI 304 liga 18-8 escovado, com varando Modelo mais baixo do mercado Compartimento quente e frio Estrutura reforçada montada sobre 06 rodas de 6", sendo 04 fixas e 02 giratórios sem freio facilitando curvas e estacionamento Puxadores em ambos os lados em tubo de aço inox para manuseio e dirigibilidade Capacidade de 43 refeições – 32 na parte quente (16 cada lado)+ 11 refeições na parte fria Quantidade de portas: 03 portas Dimensões em cm: 128°X 56L X144C Peso: Aproximadamente 172Kg Tensão:220V</p> | R\$ 70.592,61 | R\$ 70.592,61 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35

Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com
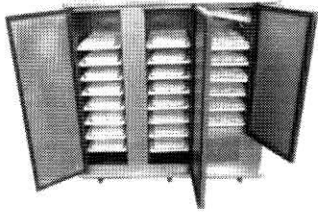
| | | | | | |
|---|----|-----|--|---------------|---------------|
| | | | <p>Consumo: 770w – parte quente 440w – parte fria Totalizando: 1300/hora (1,3Kw) Acompanha 43 bandejas lisas tamanho grande Modelo térmico mais baixo do mercado; silencioso; rodas com dupla blindagem; praticidade em curva e estacionamento; timão dos dois lados oque facilita o manuseio</p>  | | |
| 6 | 04 | UNI | <p>CONTAINER DE 1000 LITROS SEM PEDAL MARCA LAR PLASTICOS Cor: Branco O Container de 1000 Litros Sem Pedal é fabricado em Polietileno de Alta ou Média Densidade (PEAD ou PEMD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade utilizado, tais como sua resistência e durabilidade. Resistentes ao impacto e à tração, o Container de 1000 Litros Sem Pedal possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 – UV 8, da American Society for Testing and Materials (ASTM), em conformidade com a norma EN840. Têm capacidade para 450Kg e contam com rodas de PVC com 200mm de diâmetro e núcleo de polipropileno (PP). Possuem 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, o que lhes garante excelente custo-benefício. O Container Sem Pedal 1000L possui ainda, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos.</p>  | R\$ 1.673,60 | R\$ 6.694,40 |
| 7 | 01 | UNI | <p>PINÇA ORDENHA C/ CREMALHEIRA MOD 00032602 MARCA EDLO</p>  | R\$ 420,95 | R\$ 420,95 |
| 8 | 03 | UNI | <p>CARDIOVERSOR MOD VIVO BASICO MARCA CMOS DRAKE Tecnologia Bifásica Exponencial Truncada: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição de 7" (polegadas), com ajuste de contraste, sistema LAPTOP e inclinação de aproximadamente 45°, transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais, possui três modos de desfibrilação: manual, sincronizada e semi- automático. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento e transporte. Tipo de onda Bifásica exponencial truncada Joules De 1 a 200 joules bifásicos Opcional: 1 a 270 joules bifásicos** Opcional: 1 a 360 joules bifásicos** Versões 200 joules DESFIBRILAÇÃO EXTERNA: - Modo Infantil: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Joules. - Modo adulto: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90,100, 110, 120,</p> | R\$ 17.668,20 | R\$ 53.004,60 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda





CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

150, 180, 200 Joules. A carga é ajustada manualmente, com instruções de operação no próprio painel do CARDIOVERSOR, ou outra qualquer configuração de energia desejada pelo usuário. Carga infantil Possui sistema de segurança inteligente que limita a carga a 50J para uso infantil, ao desenroscar as alpacas adultas das pás permanentes. Cargas pré configuradas O equipamento quando em modo DEA (automático), obedece a escala de 150-200 e 200 joules. Forma de ativação de carga A carga (joules) pode ser selecionada pelas pás, pelo painel e pelo botão navegador, quando selecionado pelas pás, utiliza-se a pá APEX para selecionar a energia, a pá STERNUM para carregar e pressionando simultaneamente os dois botões sendo um em cada pá para disparar, minimizando desta forma o risco de choques acidentais. Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, 1 para selecionar a energia, 2 para carregar e 3 para disparar (tratamento).
 Detecções Detecta e rejeita pulso de marcapasso Pás permanentes Intercambiáveis adulto e infantil, multifuncionais. Impedância torácica Analisa automaticamente a impedância torácica do paciente aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo os riscos de injúrias cardíacas. Detecção de impedância na faixa de 250 Ohm à 500 OHM para disparos. Display De cristal líquido colorida de 7", de alta resolução, com sistema LAP-TOP e inclinação de aproximadamente 45°. Indicadores no display para visualização Indicação clara das fases, carregando, pronto, descarregando e desarmando. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Programação de indicador de beep, status da bateria e outros. Indicador de contato das pás Possui indicador de contato das pás no tórax do paciente visualizados no display de cristal líquido em forma de bargraph e/ou nas próprias pás de choque através de leds indicativos. Indicador de contato das pás com o paciente apresentando no display a intensidade do contato. Dados visualizados no display** Traçado de ECG, traçado de SPO2, traçado de ETCO2, dados da PNI, derivações, frequência cardíaca, indicador do beep, faixa de oximetria de pulso com valores da saturação, pulso, status da bateria, alarmes máximos e mínimos de todos parâmetros, pulso de marcapasso, energia selecionada, energia entregue, filtro, velocidade do traçado, amplificador, indicador de carga da bateria, led indicativo de está carregado ou em carregamento. OBS: para visualização no display dos parâmetros é necessário que o equipamento os contemple. Todo cardioversor da marca CMOS DRAKE possui configuração básica de fábrica de ECG/DEFIBRILADOR. Alarmes sonoros e visuais** Alarmes de eletrodo solto, bradicardia, taquicardia, baixa e alta de SPO2, sensor desconectado, manguito solto, alarmes de baixa e alta de PNI, ETCO2, bateria fraca. Possui tecla de silenciamento de alarmes por 02 minutos. Bateria Bateria interna, com capacidade de até 220 choques (disparos) com carga de 200J; 50 choques (disparos) com carga de 360J ou até 4 horas de monitoramento. Recarga da Bateria Carregador de bateria interno que realiza todo o controle de carga da bateria automaticamente com tempo de carga de aproximadamente 4 horas. Tempo de carga Com uma bateria nova e plenamente carregada ou pela alimentação da rede elétrica, seu tempo de carga é menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 6 segundos para 270 e 360 joules. Anula carga Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, ou manualmente através da tecla anula carga a critério do usuário em qualquer tempo; Cronometro Relógio contador se segundos, data e contador de choques. Teste no equipamento Realiza auto-teste diário ao ser ligado Teste nas pás Realiza teste de funcionamento das pás com indicação luminosa. Idiomas disponíveis** Português, Espanhol e Inglês Sincronização Realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de energia menor que 20ms. Tempo máximo de retardo para estabilização do sinal em 5 segundos após conexão ideal do sensor ao paciente. Peso Total Aproximadamente 4,0 kg incluindo todos os acessórios Alimentação Automática 90 a 240 VAC – 50/60 Hz – Fonte de alimentação integrada – Bivolt. Condições da temperatura 0-50°C, armazenamento: 0-70°C, umidade operacional: 10-95% RH, sem condensação, compatibilidade eletromagnética irradiada e conduzida CISPR11. Grau de Proteção IP 44
 Procedência NACIONAL RMS 80058130015
 ECG - ELETROCARDIOGRAMA
 Derivações (03)
 ou Derivações (12)
 DI, DII, DIII (cabo paciente de 03 vias).
 DI, DII, DIII, aVL, aVR, AVF, V1 a V6 (cabo paciente de 5 vias).
 Captação do sinal de ECG Pelas pás permanentes do desfibrilador, pelas pás adesivas do marca passo e pelo cabo de paciente.
 Frequência cardíaca De 10 até 300 BPM, exatidão de 01 BPM com apresentação numérica
 Sensibilidade Etapa de amplificação do ECG, 5,10,15,20,30 e 40 mm/mv
 Rejeição Em modo comum maior que 90 dB
 Proteção Proteção contra desfibrilador ou cardioversor, filtro rejeita, faixa de 35 hz e 60 hz, passa baixa 120 hz e passa alta 05 hz.

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

G & G HOSPITALAR

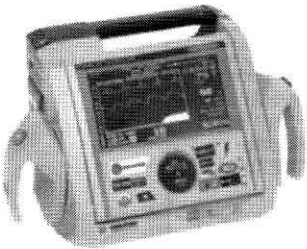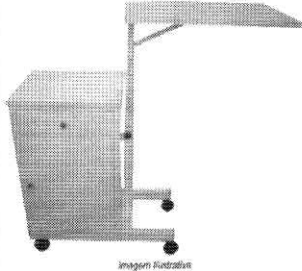

| | | | | | |
|----|----|-----|---|------------|---------------|
| | | |  | | |
| 9 | 05 | UNI | <p>TERMÔMETRO TIPO ESPETO DIGITAL MOD 7427 MARCA INCOTERM Termômetro Digital para Máxima e Mínima / Com alarme Interna -20°C a 50°C Externa -50°C a 70°C</p>  | R\$ 113,00 | R\$ 565,00 |
| 10 | 04 | UNI | <p>MOCHO GIRATORIO INOX, ASSENTO INOX, SEM RODÍZIOS MOD RN09005 MARCA RENASCER - Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304 - Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura - AISI430 - Assento com 350mm de diâmetro - Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304 - Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado - 04 pés com ponteiros plásticos Dimensão aproximada: 350 mm - Altura Máxima: 700 mm Capacidade aproximada: Até 110Kg</p>  | R\$ 360,15 | R\$ 1.440,60 |
| 11 | 50 | UNI | <p>MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA MOD RN07027 MARCA RENASCER - Gabinete construído em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura - Tampo da mesa e de refeição em MDF c/ revestimento em laminado decorativo - Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço - Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço cromado - Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores em material plástico - Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso Dimensão aproximada: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima: 1230 mm</p>  | R\$ 950,20 | R\$ 47.510,00 |

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com

G & G HOSPITALAR

015 J
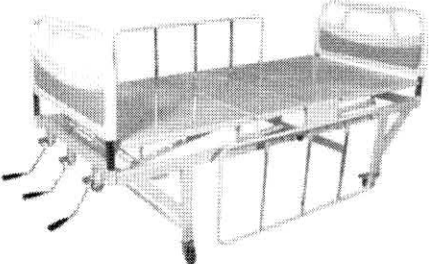
| | | | | | |
|----|----|-----|---|--------------|----------------|
| 12 | 30 | UNI | <p>CAMA HOSPITALAR P/ U.T.I, CAB/PES. EM POLIURETANO INJETADO, COM GRADES INOX MOD RN14101 MARCA RENASCER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura do leito em aço carbono tubular quadrado 30x50 x 1.20mm - Leito em chapa de aço perfurada de 1.5mm de espessura - Permite movimentos Fowler, Trendelemburg e Proclive - Três manivelas cromadas e escamoteáveis - Pára-choque de borracha redondo nos quatro cantos da cama - Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado - Grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – 304AISI - Pés com rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal - Acompanha suporte de soro com 2 ganchos (T) em aço inox – 304AISI - Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso <p>Dimensão aproximada: 1900 x 900 x 650 mm – Capacidade Aprox.: Até 150Kg Registro MS: 80430259008</p>  <p>Imagem Ilustrativa</p> <p>Legenda dos movimentos do leito</p>  <p>Fowler 60° Fowler 30° Trendelemburg Proclive</p> | R\$ 4.695,80 | R\$ 140.874,00 |
|----|----|-----|---|--------------|----------------|

Att.


 Edilberto Greinert
 (45) 9923-0087
 E-mail: edilgrein@hotmail.com


10 471 797 / 0001 - 69

EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA

Rua Fortaleza, 3782
 Recanto Tropical - 85807-090
 CASCAVEL - PARANA

Edilberto Greinert & Cia Ltda

CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
 Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical CEP: 85.807-090 Cascavel – PR
 Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774 E-mail: edilgrein@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

Olá

CASCADEL, 28 DE AGOSTO DE 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL
JAGUARIAIVA - PARANÁ

PROPOSTA 0044/2019

| ITEM | QT | UNI | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL |
|------|----|-----|---|---------------|----------------|
| 1 | 04 | UNI | <p>NEBULIZADOR INALADOR 4 SAIDAS / MEDICATE</p> <p>Indicações Indicado para Nebulização em Clínica, Consultório, Hospital, Pronto-socorro, Ambulatório; O MD 400 BI-POWER é utilizado para produção de ar comprimido, isento de óleo ou impurezas; É indicado para uso profissional, para a nebulização em aerossol e tendas de oxigênio; Este inalador é prescrito a seres humanos no tratamento ou alívio de doenças respiratórias; Diferenciais e benefícios Funciona com dois motores elétricos de alto rendimento com pistão oscilante, proporcionando uma inalação contínua suave; Design arrojado; Prático e resistente; Alça para Transporte; Proteção térmico; Copo modelo turbo; Bivolt automático; Válvulas de ar com 4 saídas, podem ser utilizadas as 4 simultaneamente.</p> <p>Itens inclusos 01 Aparelho Compressor; 04 Máscara adulta; 04 Máscara infantil; 04 Copos modelo turbo capacidade 10ml cada; 04 Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metros, encaixe e rosca; 01 Folheto com manual de instruções; 01 Relação de Assistências Técnicas Autorizadas; 01 Cabo de força.</p> <p>Altura do produto (cm) 30,00 Largura do produto (cm) 26,00 Profundidade do produto (cm) 34,00 Peso líquido (Kg) 5,910</p> <p>Higiene e Conservação Para limpeza, utilize apenas pano embebido em álcool ou levemente umedecido em água e detergente neutro, tomando cuidado para que líquidos não penetrem no interior do aparelho; Nunca jogar água sobre o equipamento; Faixa de temperatura para transporte e armazenamento: -5° a 40°C.</p> <p>MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: Desinfecção com solução diluída de quaternário de amônio (92000 a 3000 oom);</p> <p>Especificações: Tensão: 127 / 220V~Bivolt automático Plugue 3 pinos; Frequência: 60 Hz; Fusível: 5 A - Ação rápida - 2 cm; Proteção térmica: <150°C; Compressor: Pistão oscilante (isento de óleo); Potência nominal total: 150W ou 1/5CV; Pressão máxima: >30 PSI; Corrente elétrica nominal total: >127V: < 1,4A; Tempo de Nebulização: em torno de 15 minutos (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.</p>  | R\$ 1.749,90 | R\$ 6.999,60 |
| 2 | 05 | UNI | <p>PERFURADOR CANULADO PNEUMATICO / MACOM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acionamento no gatilho • Destinado à perfuração óssea • Confeccionada com material leve e resistente | R\$ 20.100,05 | R\$ 100.500,25 |

S GUIMARAES - EIRELI - ME


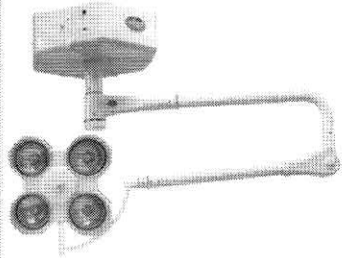

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com

HOSPITALAR GUIMARAES

| | | | | | |
|---|----|-----|--|---------------|---------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Mandril em aço inoxidável com abertura de até 6,5mm • Mandril em aço inoxidável com abertura de até 9,5mm • Empunhadura anatômica • Material totalmente autoclavável • Rotação de 0 a 1.000 RPM progressiva • Funcionamento em sentido horário e anti-horário • Acompanha maleta de acondicionamento e transporte e caixa para esterilização  | | |
| 3 | 01 | UNI | <p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO FL-2000 T4 E / MEDPEJ</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de iluminação com 4 bulbos - Bulbos halógenos de 12 v X 55 watts - Luminosidade aproximada de 80.000 LUX - Espelho óptico e filtro com fornecimento de luz fria, branca e uniforme - Braço giratório - Haste articulável e giratória - Rotação de 360° graus - Acabamento em PSAI poliestireno de alto impacto e alto brilho - Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2 <p>Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação</p> <p>Assistência técnica permanente</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Foco de Luz de Teto FL 2000 T4 - 01 - Manual de instruções. - 01 - Manopla removível e autoclavável.  | R\$ 19.216,00 | R\$ 19.216,00 |
| 4 | 05 | UNI | <p>CARRO DE EMERGENCIA / ECAFIX</p> <p>Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos. Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral. Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos.</p> <p>Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.</p> <p>Acompanha: Suporte para soro com altura ajustável, Tábua para massagem cardíaca em acrílico, suporte para cilindro de oxigênio e Trava para gavetas / basculante. Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm, peso: 63 Kg.</p>  | R\$ 2.879,50 | R\$ 14.397,50 |

S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR



Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

017
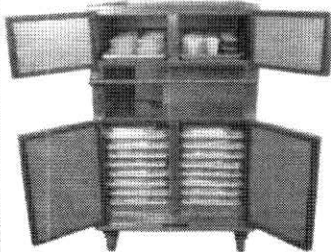
| | | | | | |
|---|----|-----|---|---------------|---------------|
| 5 | 01 | UNI | <p>CARRO TÉRMICO REFRIGERADO DE TRANSPORTE FECHADO TRM</p> <p>*Construído em aço inox padrão AISI 304 liga 18-8 escovado; *Mostrador de temperatura fria / ambiente; *Dotado de 02 portas em aço inox com trincos; *Dotado de identificação por gravação química (para não dificultar a higienização), constando modelo, ano de fabricação, número de série, data e telefone SAC para assistência técnica; *Estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios sem freio de 6", com rodas maciça; *Dotado de puxador em tubo de aço inox diâmetro 1" com parede 1,20 mm para manuseio e dirigibilidade; *Possui 20 pares de cantoneiras internas, para acomodar todos os produtos ALBAN para que não fiquem soltos criando barulhos desnecessários. *Possui pára-choque de proteção na cor cinza em toda sua volta; *Acompanha duas bandejas lisas, tamanho G, disponível nas cores: Azul, Bege, Marfim ou Verde;</p> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <p>* Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. * Assistência técnica permanente;</p> <p>- A altura da primeira é de 19 cm e as demais com distância de 9,5 cm entre elas;</p> <p>* Dimensões em cm: 1,28 alt. X 0,63 larg. X 0,90 comp;</p> <p>* Capacidade Máxima: 22 bandejas ou 44 pratos ou sopeiras;</p> <p>* Opções: com ou sem lixeira na parte abaixo do timão;</p> | R\$ 72.198,66 | R\$ 72.198,66 |
| | | |  | | |
| 6 | 04 | UNI | <p>CONTÊINER C100 INOVA</p> <p>injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD). Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados</p> | R\$ 1.809,20 | R\$ 7.236,80 |
| | | |  | | |
| 7 | 01 | UNI | <p>PINÇA ORDENHA HARTE</p> | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| 8 | 03 | UNI | <p>MONITOR CARDIOVERSOR BIFÁSICO CARDIOMAX INSTRAMED</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões com pés:<ul style="list-style-type: none">- 30,0 cm (largura).- 21,5 cm (profundidade).- 28,0 cm (altura).• Peso:<ul style="list-style-type: none">- Aparelho - 5,15 Kg.- Bateria NiMH - 1,10 Kg.- Bateria Li-Ion - 0,60 Kg.- Pés externas - 0,85 Kg.- Equipamento completo (bateria NiMH)<ul style="list-style-type: none">- 7,10 Kg (exceto PANI).- Equipamento completo (bateria Li-Ion)<ul style="list-style-type: none">- 6,60 Kg (exceto PANI).• Elétrico:<ul style="list-style-type: none">- AC: 100 a 220 VAC, 50/60 Hz (seleção automática).- DC externo: 11 a 16 VDC.• Bateria recarregável removível:<ul style="list-style-type: none">- Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h.- Duração: Bateria com carga plena<ul style="list-style-type: none">- 3 horas em modo monitor, sem | R\$ 18.546,60 | R\$ 55.639,80 |

S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com

HOSPITALAR GUIMARAES

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.- BATERIA **:- Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h.- Duração: Bateria com carga plena- 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules.- Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.- **Consultar disponibilidade.• Memória:- Tipo: Flash Nand.- Capacidade: 2 Mbytes.- Pacientes armazenados: > 150 pacientes.- Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel.- ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA• CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria tipo Li-Ion):- Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. <p>ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura:- Operacional: 0 a 50 °C.- Armazenamento: -20 a 50 °C.• Umidade:- Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação.- Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação.• Índice de Proteção: IPX1. <p>DEFIBRILADOR</p> <ul style="list-style-type: none">• Forma de onda:- Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.• Aplicação de choque:- Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.• Desfibrilação adulto/externa:- Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis.- Comandos: Botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.- Seleção de energia: Botão de terapia no painel frontal.- Comando de carga: Botão no painel frontal, botão nas pás externas.- Comando de choque: Botão no painel frontal, botões nas pás externas. | | |
|--|--|---|--|--|

S GUIMARAES - EIRELI – ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel – PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

018 of

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Comando sincronizado: Botão SINC no painel frontal.• Auto Sequência de Carga:- Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor.• Indicadores de carga:- Sinal sonoro de equipamento carregando.- Sinal sonoro de carga completa.- LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.• Tempo máximo de carga:- (200 J): rede e bateria < 4 s.- (360 J): rede e bateria < 6 s.• Tamanho dos eletrodos:- Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm²- Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm²• Cardioversão:- < 60 ms.• Pás (opções):- Adulto e infantil externas (inclusas).- Adulto e infantil internas: (opcionais).- Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação (opcionais). <p>MÓDULO DEA</p> <ul style="list-style-type: none">• Características funcionais:- Comandos de voz, indicações visuais, instruções de RCP, USB 2.0 para conexão com PC, multi-idiomas.• USB:- USB 2.0 para transferência do eletrocardiograma armazenado em modo DEA para um PC compatível.• SoftDEA:- Software para visualização dos dados transferidos para o PC. <p>MARCAPASSO EXTERNO</p> <ul style="list-style-type: none">• Modos:- Demanda ou fixo.• Amplitude:- De 5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%.• Largura do pulso:- 20 ms (tolerância de 10%).• Frequência:- De 30 ppm a 180 ppm (incrementos de 5 ppm), precisão ± 2%.• Período refratário:- 340 ms (de 30 a 80 ppm).- 240 ms (de 90 a 180 ppm). <p>PANI</p> <ul style="list-style-type: none">• Princípio de funcionamento:- Oscilométrica.• Modo de medidas automático:- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos.• Manual:- Uma medição.• Intervalo de medidas:• Adulto:- Sistólica: 40 - 260 mmHg.- Média: 26 - 220 mmHg.- Diastólica: 20 - 200 mmHg.• Pediátrico:- Sistólica: 40 - 160 mmHg.- Média: 26 - 133 mmHg.- Diastólica: 20 - 120 mmHg. | | |
|--|--|--|--|


S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Neonatal:<ul style="list-style-type: none">- Sistólica: 40 - 130 mmHg.- Média: 26 - 110 mmHg.- Diastólica: 20 - 100 mmHg.• Limite de sobre pressão por software:<ul style="list-style-type: none">- Adulto: 290 mmHg máx.- Neonatal: 145 mmHg máx.• Proteção de sobre pressão por hardware:<ul style="list-style-type: none">- Adulto: 300 ± mmHg.- Neonatal: 150 ± mmHg.• Resolução:<ul style="list-style-type: none">- 1 mmHg.RCP Maestro**<ul style="list-style-type: none">• Assesório para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)- Feedback das compressões torácicas.DISPLAY<ul style="list-style-type: none">• Indicação de nível de bateria:<ul style="list-style-type: none">- Sim.• Tamanho:<ul style="list-style-type: none">- 128,2 mm x 170,9 mm.• Diagonal:<ul style="list-style-type: none">- 8,4".• Tipo:<ul style="list-style-type: none">- LCD TFT colorido.• Resolução:<ul style="list-style-type: none">- 640 x 480 pixels (VGA).• Velocidade de varredura:<ul style="list-style-type: none">- 12,5; 25 e 50 mm/s.ECG (suporta até 12 derivações simultâneas quando equipado com cabo)<ul style="list-style-type: none">• Entradas:<ul style="list-style-type: none">- Cabo de ECG 3 ou 5 vias.- Pás externas.- Pás multifuncionais.• Faixa:<ul style="list-style-type: none">- 15 a 350 BPM.• Precisão:<ul style="list-style-type: none">- ± 1 BPM de 15 a 350 BPM.• Rejeição em modo comum:<ul style="list-style-type: none">- Maior que 90 dB, medida segunda a norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13).• Sensibilidade:<ul style="list-style-type: none">- 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV.• Filtro de linha de CA:<ul style="list-style-type: none">- 60 Hz ou 50 Hz.• Frequência de resposta ECG:<ul style="list-style-type: none">- Modo Diagnóstico - (0,05-100 Hz).- Modo Monitor - (1-40 Hz).• Isolamento do paciente:<ul style="list-style-type: none">- À prova de desfibrilação- ECG: Tipo CF.- SpO2: Tipo CF.• Eletrodo solto:<ul style="list-style-type: none">- Identificado e mostrado com alarme de baixo nível.• Tempo de restabelecimento da linha base do ECG após desfibrilação:<ul style="list-style-type: none">- ≤ 3 segundos.SpO2<ul style="list-style-type: none">• Faixa SpO2<ul style="list-style-type: none">- 0 a 100 %.• Faixa Pulso:<ul style="list-style-type: none">- 30 a 250 BPM.• Precisão SpO2:<ul style="list-style-type: none">- ± 2 % de 70 a 100%.- ± 3 % de 50 a 69%.• Precisão Pulso: | | |
|--|--|--|--|


S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

Old J

| | | | | | |
|----|----|-----|---|-------------------|---------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- ± 2 BPM.• Velocidade de varredura:<ul style="list-style-type: none">- 12,5; 25 e 50 mm/s. CAPNOGRAFIA <ul style="list-style-type: none">• Intervalo de medida CO₂:<ul style="list-style-type: none">- 0 - 99 mmHg.• Precisão:<ul style="list-style-type: none">- ± 2mmHg de 0 - 38mmHg- ± 5% + 0,08% para cada 1 mmHg acima de 38 mmHg (39 - 99 mmHg).• Consumo:<ul style="list-style-type: none">- 1,5 W.• Compensação:<ul style="list-style-type: none">- BTPS, N₂O, O₂. NORMAS: <ul style="list-style-type: none">- NBR IEC 60601-1- NBR IEC 60601-1-2- NBR IEC 60601-1-6- NBR IEC 60601-1-8- NBR IEC 60601-2-4- NBR IEC 60601-2-27- NBR IEC 60601-2-30- NBR IEC 60601-2-49 ou IEC's equivalentes | | |
| 9 | 05 | UNI | TERMO DIGITAL TECNO O Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna 0°C à 50°C Externa -50° 7666.02.0.00 é um instrumento de medição com visor de fácil leitura e design arrojado, destinado para medir a temperatura e umidade ambiente. Principais características <ul style="list-style-type: none">- Mede temperatura externa e interna;- Possui função máxima e mínima;- Umidade interna;- Possui botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;- Possui botão temperatura interna/externa;- material: plástico ABS;- Atende as Portarias RDC 21/2004 (Serviço de Alimentação) e RDC 44/2009 (Farmacias Drogarias e Outros); | R\$ 246,60 | R\$ 1.230,00 |
| 10 | 04 | UNI | MOCHO BANCO GIRATÓRIO ALTURA REGULÁVEL TOTALMENTE INOX COM RODÍZIOS MEDCLEN Mocho Banco Giratório Totalmente Inox para consultório ginecológico, consultório odontológico, laboratório e clínica médica em geral. Banco mochos com altura regulável. ESPECIFICAÇÕES: <ul style="list-style-type: none">- Mocho banco giratório com altura máxima de 70cm- Armação em tubo de aço inox redondo;- Assento com 350mm de diâmetro;- Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura; | R\$ 489,50 | R\$ 1.958,00 |

S GUIMARAES - EIRELI - ME




CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.ghospitalar@hotmail.com

HOSPITALAR GUIMARAES

| | | | | | |
|----|----|-----|---|--------------|----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo; - Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado; - 04 pés com Rodfzios; <p>Dimensões externas aproximadas: 450x450x500mm Altura Máxima: 700mm</p>  | | |
| 11 | 50 | UNI | <p>MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA MEDCLEAN Totalmente construída em MDF com revestimento em laminado decorativo (externo) Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço inox redondo Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores cromados Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Dimensão aproximada: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima: 1230 mm</p>  | R\$ 1.249,80 | R\$ 62.490,00 |
| 12 | 30 | UNI | <p>CAMA HOSPITALAR FAWLER 3 MANIVELAS 2762 GRUPO BOND A estrutura da Cama é construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidos regularmente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama que fabricamos. É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. Cabeceiras e Peseiras removíveis produzidas em material termoplástico de alta-resistência. O cliente também pode escolher cores nos detalhes de acabamento das Cabeceiras e Peseiras. Consulte cores disponíveis. Estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe "trava" e "destrava". Eletrostática em epóxi na cor branca. Nossas camas passam por 8 rígidos processos de fosfatização onde prepara as superfícies metálicas para permitir uma boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão tais como a ferrugem. Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal.</p>  | R\$ 6.234,78 | R\$ 187.043,40 |

S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com



HOSPITALAR GUIMARAES

Handwritten signature

PAGAMENTO: A VISTA
ENTREGA EM: ATÉ 30 DIAS
TIPO DO FRETE: POR CONTA DO DESTINO

25 079 031 / 0001 - 00

S GUIMARAES - EIRELI-ME

Rua Magnolia, 104
Parque Verde - CEP 85807-780
CASCAVEL - PARANA

Handwritten signature of Sirlene Guimarães

SIRLENE GUIMARÃES
DIRETORA

S GUIMARAES - EIRELI - ME

CNPJ: 25.079.031/0001-00 Rua: Magnolia, 104

Bairro: Parque Verde CEP: 85.807-780 Cascavel - PR

Fone: (45) 3039-6188

E-mail: adm.gghospitalar@hotmail.com

DORMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ: 01.505.499/0001-51 | Avenida Amintas Jacques de Moraes, nº 800 | Bairro Coqueiros | Cep: 30.881-202 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Alvará Sanitário Municipal nº 2018002550 | Autorização de Funcionamento AFE ANVISA nº UH51WW6875YX. Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição de Produtos para a Saúde CBPADPS ANVISA conforme Resolução RE Nº 4.526 de 1º de outubro de 2010.

[Bem vindo! Faça seu login ou cadastre-se.](#)
[Meus Pedidos](#)
[Sobre Nós](#)
[DIPACAMENTOS vendas@dormed.com.br](#)
[\(31\) 3474-9151](#)
[\(31\) 99861-7889](#)




O que você está procurando?

Bom dia, Visitante (ENTRADA)

Navegue pela loja

Página inicial | Saúde e Beleza

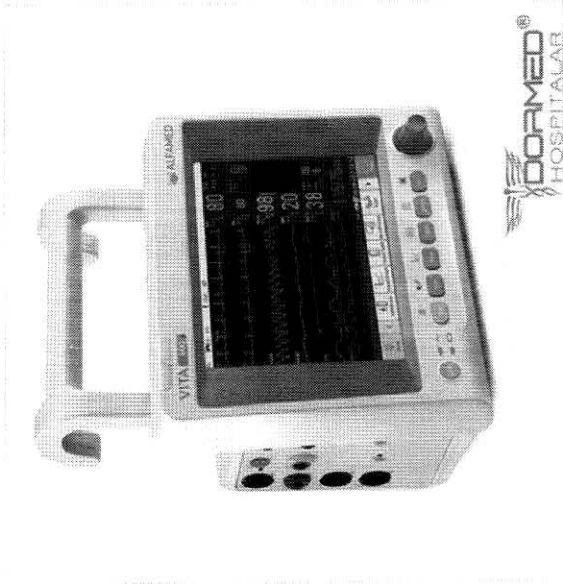

Monitor Multiparametro 8.4" Vita600E - Alfamed (Cod. MDH04059001)

★★★★★ **AVANCEZ COM CONFIANÇA**

R\$ 8.105,00

Por R\$ 7.699,75 no boleto.

ou 3x de R\$ 2.701,66 sem juros
ou 12x de R\$ 765,93 com juros de 1,99%
Formas de Parcelamento

COMPRAR

Comprar com um click

Envio Em 5 Dias Úteis Após a Confirmação do Pagamento



Handwritten signature




O que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

- Ver Todas
- Estereilização
- Kit
- Odontologia
- Fisioterapia
- Desfibriladores
- Salúde em Casa
- Meias de Compressão
- Produtos 3M
- Avaliação Física
- Estetoscópios
- Balanças
- Aparelhos Médicos
- Equipamentos Médicos

Página Inicial | Equipamentos Médicos | Monitores de Sinais Vitais/Cardíaco

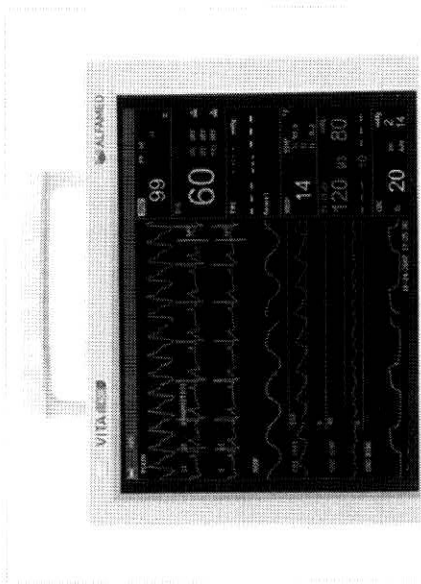

Monitor Multiparâmetro VITA 400a Básico (ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2, PNI, Temp.) - Alfamed

Cod. de Referência: VITA400a-1

世界 世界 世界

Por: R\$ 9.800,00 (ou R\$ 9.114,00 para pagamento à vista) ou 10x de R\$ 980,00 sem juros. Formas de Parcelamento

COMPRAR

Fale conosco

Produtos Hospitalares Online
CNPJ 21.839.639/0001-35
R. João Alencar Guimarães, 305 - Santa Quitéria
Curitiba - PR
CEP 80310-420
Fone: 0800 00 63656
WhatsApp: (41) 99123-1772

Handwritten signature and number 022



Saúde é o nosso foco


MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - CNPJ 26.084.230/0001-70 Endereço Rua Capitão Otávio Machado 191-A, Chácara Santo Antonio, São Paulo, SP - CEP 04718-000 Telefone: (11) 2348-8710 - Whatsapp (11) 96669-6133 - Email: contato@medaxo.com.br

[Busque na loja toda...](#)
Minha Conta
Seu Carrinho

Todos os Departamentos
Locomoção
Aparelhos Médicos
Resgate e Salvamento
Equipamentos
Móveis Hospitalares
Descartáveis

MESA CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA SL

cód Ref: CDS8002

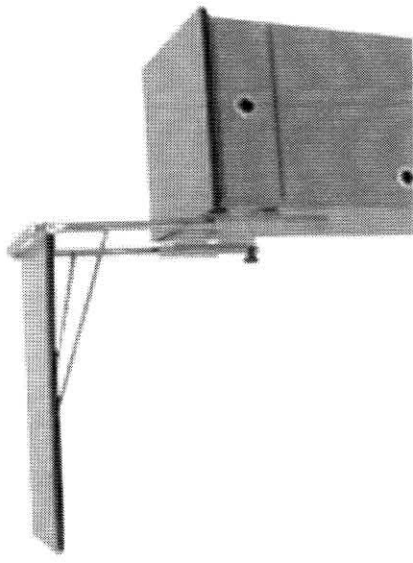

R\$807,50
5% de desconto no boleto bancário

R\$850,00
6x de R\$141,67 s/ juros no cartão
ou 12x de R\$85,34 iguais



Pague com desconto no boleto bancário ou débito em conta

Quantidade: +

COMPRAR

Tem preço melhor? Ligue para a Medaxo

Opções de Parcelamento no Cartão

024

DORMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ: 01.505.499/0001-51 | Avenida Amintas Jacques de Moraes, nº 800 | Bairro Coqueiros | Cep: 30.881-202 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Alvará Sanitário Municipal nº 2018002550 | Autorização de Funcionamento AFE ANVISA nº UH51WW6875YX. Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição de Produtos para a Saúde CBPADPS ANVISA conforme Resolução RE Nº 4.526 de 1º de outubro de 2010.

Bem vindo! Faça seu login ou cadastre-se.

Meus Pedidos | Sobre Nós | vendas@bornet.com.br | (31) 3474-9151 | (31) 99851-7889

DORMED[®]
HOSPITALAR

O que você está procurando?

Bom dia, Visitante (entrar)

COMPRAR

Comprar com um click

Prazo de envio 45 dias úteis

Página Inicial | Móveis Hospitalares | Banco Giratório

Navegue pela loja

Banco Giratório de 4 Pés Inox com Rodízios MVM-205R - MVM (Cod. BCO00606095)


RS 684,00

Por R\$ 663,48 no boleto.

ou 3x de R\$ 228,00 sem juros

ou 12x de R\$ 64,64 com juros de 1,99%

Formas de Parcelamento

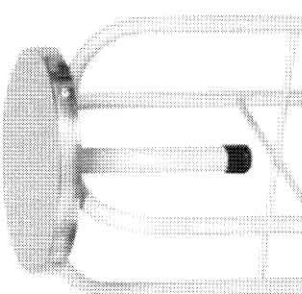


025 A



PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ: 04895143/0001-60 | AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 6848 | BOQUEIRÃO | CURITIBA - PR | CEP: 81650-000

[Home](#) | [WhatsApp](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Google+](#) | [Pinterest](#) | [Vimeo](#) | [SoundCloud](#) | [RSS](#) | [Sitemap](#) | [Legal](#) | [Contato](#) | [Fale conosco](#) | [Faça Login](#) | [ou Cadastre-se](#)




PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

[TODOS DEPARTAMENTOS](#) | [ACESSIBILIDADE](#) | [ACESSÓRIOS MONITORIZAÇÃO](#) | [CONFORTO E TRATAMENTO](#) | [EQUIPAMENTOS MEDICOS](#) | [MÓVEIS](#)

Página inicial > Móveis > Bancos e Mobílias > Mocho Banco Giratório Totalmente Inox com Rodízios

Mocho Banco Giratório Totalmente Inox com Rodízios

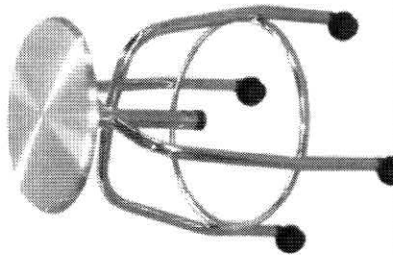

Disponibilidade: Em estoque

Avaliação: ☆☆☆☆

Prazo para postagem: 25 dias úteis

REF: 2023322

Compartilhe este produto:

Por R\$ 371,53
desconto de 6% no boleto
R\$ 348,40

R\$ 395,25
6x de R\$ 65,88 ⁷ juros

COMPRAR

ADICIONAR

Formas de pagamento

[Calcule o Frete](#) | [Envie-nos uma mensagem](#) | [jivochat](#)

10:48 07/09/2019

Handwritten signature

Mobraz

Mobraz.com.br Rua Saint Hilaire, 230 Água Verde, Curitiba-Pr CNPJ: 16.899.541/0001-33

CNPJ: 04.589.017/0001-87 | 04589017000187 R Prudente De Moraes, 2639 | Sao Jose Do Rio Preto - SP, CEP: 15025-045

INNOVA
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

Desconto de até 10% via televendas 11 2408-8966 ou zapvendas 11 94384-4396

MESAS

CADERAS

KIT MESAS/CADERAS

LIXEIRAS


HIGIENE/LIMPEZA

TRANSPORTE/ARMAZENAGEM

CONDOMÍNIOS

UTILIDADES DOMÉSTICAS

MADEIRA PLÁSTICA

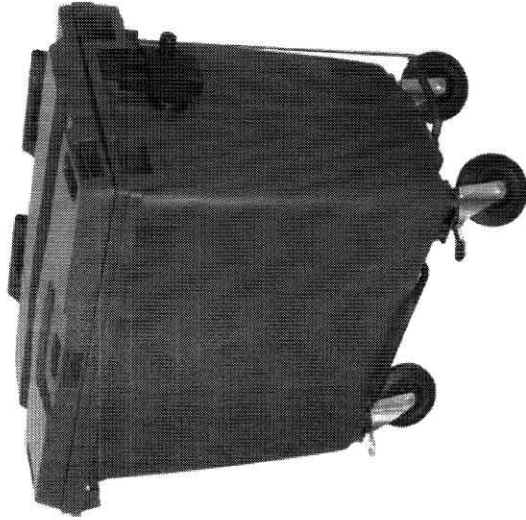

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Condomínios, Container, Higiene/Limpeza

Contêiner De Lixo De 660 L Com Pedal

Injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD). Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados.

R\$1.526,18

COR

Escolha uma opção ▾




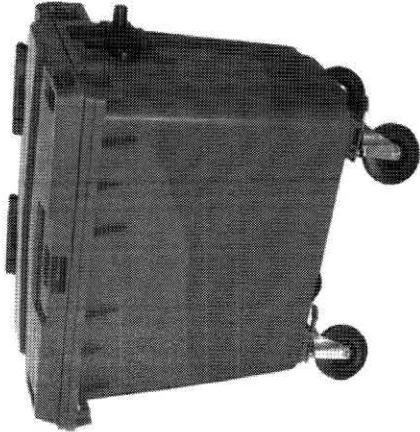
027

← → C carrinhosbrasil.com.br/lixeira-700lts-4rodas Carrinhos Brasil

Fale Conosco Tel. (19) 3519-3850 O que você procura? Carrinho vazio

Lixeira 700 lts - 4 rodas

Código: CRB201




R\$ 1.604,25
ver até 12x de R\$ 161,06 parcelas

Estoque: 8 dias úteis [+ Lista de Desejos](#)

Comprar

Calcule o frete

OK



058 fs



PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ: 04895143/0001-60 | AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 6848 |

BOQUEIRÃO | CURITIBA - PR | CEP: 81650-000 | [Mapa do site](#)



PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES



O que você procura?



Fale conosco

Faça Login

ou Cadastre-se



TODOS DEPARTAMENTOS

ACESSIBILIDADE

ACESSÓRIOS MONITORIZAÇÃO

CONFORTO E TRATAMENTO

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

MÓVEIS

[Página inicial](#) > [Carro de Emergência e Parada CP1000 Ecáfis](#)

Carro de Emergência e Parada CP1000 Ecáfis

Disponibilidade: Em estoque

Avaliação: ☆☆☆☆

Ref: 200725

Prazo para postagem: 20 Dias úteis



Compartilhe este produto:

por R\$ 5.404,06
desconto de 6% no boleto
R\$ 5.749,00
6x de R\$ 958,17 s/ juros



COMPRAR

ADICIONAR

Formas de pagamento

Calculadora

Handwritten signature



CLINMED RIO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI / CNPJ: 12.467.446/0001-00.
Av. Presidente Vargas, 590 / 510. Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP 20.071-000. Credito nº 004002-RJ

contato@clinrio.com.br

Meu Carrinho



Carro de Emergência GRN Modelo G-34 - Gigante



R\$ 4.400,00
R\$ 4.400,00

Total: R\$ 4.400,00

CLINRIO

030 dh

[Inalador Hospitalar 4 Saídas](#) | [Inalador Hospitalar 4 Saídas](#) | [Inalador Hospitalar 4 Saídas](#) | [Magazine Médica | NE](#) | [Inalador com 4 saídas](#) | [Inalador com 4 saídas](#)

[https://www.hospitalardistribuidora.com.br/aparelhos/inalador-com-4-saidas-medicate.html?gclid=EAtaIqobChMI5sP18cnf4wIvISRCr0sGgALEAMYASAAEgKZl_D_BwE](#)

Olá, seja bem vindo(a)! [Faça login](#) ou [cadastre-se](#)

Pesquisar um produto

HOSPITALAR
Distribuidora


TODOS OS DEPARTAMENTOS

Seringas | Medicamentos | Scalps | Equipos | Sondas | Cateter | Compressa | Aparelhos | Luvas | Agulhas

Atendimento | Minha Conta | Meu Carrinho

Home » APARELHOS » INALADORES E NEBULIZADORES » Inalador com 4 saídas - Medicate

Inalador com 4 saídas - Medicate

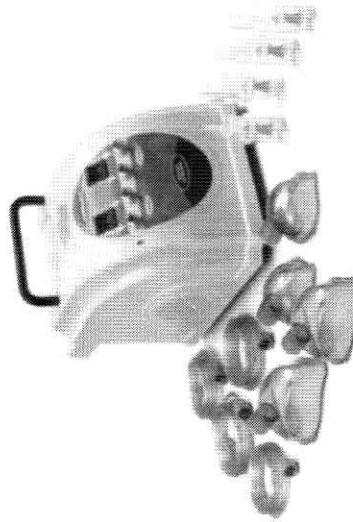

R\$ 2.020,00
 até 3x de R\$ 673,33 s/ juros
 ou **R\$1.959,40** à vista

Ver opções de parcelamento

DIGITE SEU CEP

OK

1

+

-

COMPRAR

SITE 100% SEGURO

Porque comprar na HD:
 Desconto para pagamento à vista
 Entrega garantida para todo o Brasil
 Produto 100% Original
 Compra Segura
 Parcelamento sem juros

Conversar conosco

03103

.375.328/0001-80 Inscrição Estadual: 562.172.900.119 Central Telefônica: (18) 3221 2232 e (18) 98171 6082 (WhatsApp)

VIMARCA MEDICA
Atendimento ao Cliente

Home / Inalador Nebulizador Hospitalar 4 saídas

Inalador Nebulizador Hospitalar 4 saídas

SKU: M4440

Preço: R\$1.363,00
Preço com desconto: **R\$1.294,85** (5% de R\$681,50 em juros)

Parcelamento no cartão:
1x de R\$1.294,85
2x de R\$647,43
3x de R\$431,62
4x de R\$346,71
5x de R\$258,77


Medicador Hospitalar MD-400 4 saídas (P) - Medicate

COMPRAR **COTAR**

31/07/2019

0320

033 of

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---------------------|-----------|------|----|
|  MARTEC MED | | Orcamento Venda | | | Nº. 19-00290 | | | |
| | | MARTEC MED I C EQ MED HOSP LTDA EPP | | | Pag.: 1 | | | |
| Endereço: RUA LASAR SAGALL, 755 Município: RIBEIRAO PRETO Estado: SP CNPJ: 00.825.332/0001-61 e-mail: martec@martecmed.com.br Vendedor: 04809-ERPAVI REPRESENTACOES COMERCIAIS L | | Bairro: CENTRO Estado: PR Inscr./RG: ISENT0 CEP: 84200-000 Pedido: | | RIBEIRAO PRETO 15/08/2019 17:09:02 LETICIA | | | | |
| Cliente: 05316-FUNDO MUN. DE SAUDE DE JAGUARIVA Data.: 15/08/2019 | | | | | | | | |
| Endereço: PC GETULIO VARGAS 60 Município: JAGUARIVA CNPJ/CPF: 10.952.292/0001-16 Telefone: (43) 3535-1233 Fax e-mail: Contato: ALEX | | | | | | | | |
| Referente | | | | | | | | |
| 001 VENDA | | | | | | | | |
| EXPEDICAO 20 DIAS APOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO E FORMULARIO DE MEDIDAS PREENCHIDO | | | | | | | | |
| TAXA DE INSTALACAO JA INCLUSA NO VALOR DO FRETE | | | | | | | | |
| Negociacao | | | | | | | | |
| Sq | Descrição do produto | | UN | Cide. | VLUnitario | VLTotal | ICMS | IP |
| 001 | FOCO CIRURGICO M300TETO 6B C/ EMERG LED | | UN | 1,00 | 16666,6700 | 17000,00 | 12 | 2 |
| | | | Frete | | | 1.850,00 | | |
| | | | Total Geral | | 1,00 | 18.850,00 | | |
| Condições | | | | | | | | |
| Transportadora | | | | | | | | |
| Redespacho | | | | | | | | |
| Tipo Frete | | | | | | | | |
| Fob | | | | | | | | |
| Ver Item | | | | | | | | |
| Prazo Entrega | | 01 16/08/2019 (001) 4.712,50 | | | | | | |
| Vencimento | | 02 14/09/2019 (030) 4.712,50 | | | | | | |
| | | 03 14/10/2019 (060) 4.712,50 | | | | | | |
| | | 04 13/11/2019 (090) 4.712,50 | | | | | | |
| Atenciosamente, | | | | | | | | |

PROPOSTA Nº
11869
VALIDADE DA PROPOSTA:
28/08/2019

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Rua Castro, 29 Cruzeiro - São José dos Pinhais - PR - CEP 83010-080
CNPJ: 79.805.263/0001-28 I.E.: 10.500.203-35
Fone: (+55) (41) 3382-2066 Fax: (+55) (41) 3382-2066
e-mail: kss@grupokss.com.br - site: www.grupokss.com.br

CLIENTE
2367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAIVA
Praça Getulio Vargas, 60 - Centro - Jaguariaiva / PR - CEP 84200-000
CNPJ: 10.952.292/0001-16
I.E.: ISENT0

Contato: MARIANA Fone: (+55)(43)3535-1233 E-mail: mari-mfr@hotmail.com

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Transportadora:
Cond. Pqto: 30 DIAS DA FATURA
Sinal: R\$0,00

Responsável p/ Pedido: GIULIANO_M - vendas@grupokss.com.br
Representante: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

PREÇO EMBARQUE:
30 DIAS DIRETOS
(após confirmação da proposta)

| Código | Descrição | Un. | Qtde | Vir. Unit. | Vir. IPI | Vir. Total c/ IPI | IPI % |
|--------------|--------------------------------|-----|------|------------|----------|-------------------|-------|
| 00.120.00307 | FOCO DE TETO SKYLED 160 | UN | 1,00 | 35.000,00 | 2.800,00 | 37.800,00 | 8 |

Descritivo: A KSS disponibiliza ao mercado de equipamentos médicos o Foco Cirúrgico SKYLED, fabricado conforme as normas ABNT NBR IEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-41, com tecnologia de ponta, com alta confiabilidade e durabilidade que atende aos mais variados procedimentos cirúrgicos e clínicos, dentro dos mais diversificados ambientes hospitalares, laboratoriais, clínicos e veterinários. Tudo isso aliado ao baixo consumo energia e sem a necessidade de refrigeração forçada o que garante a total ausência de

034



Digite aqui sua busca

BUSCAR

Busca de Cartuchos

Nossas Lojas 2ª via Boleto Faturado Histórico de Compras Atendimento Cartão de Compras

Olá, Usuário MINHA CONTA



MEU CARRINHO



ASSINATURA

Todas Categorias

Drones

Informática

Cartuchos

Impressoras

Notebooks

Rede

Smartphones

Apresentação

Mídias

Escolar

Escritório

Escrita

Papéis

Organização

Envelopes

Móveis

Embalagens

Automação

Telefonia

Destaque

Smartphones

Smartphones - Acessórios

Telefones

Telefones Sem Fio

Seções

Acessórios p/Elétrica e Telefonia

Audio Conferência

Bobinas para Fax

Caixas de Som Portáteis

Filtros de Linhas

Índices Telefônicos/Endereço

Site: Política Privacidade

Smartphones & Telefonia > Telefones > Keo

Veja mais produtos da: Keo

Telefone de mesa grafite K103 Keo CX 1 UN

Código: 678079



0 avaliações

Veja Similares

R\$ 32,90

Quantidade:

1

Comprar

Avaliar Produto

Descrição do Produto

Compre Junto

Indique a um Amigo

Garantia Estendida

035

A. Angeloni & Cia Ltda - CNPJ: 83.646.984/0069-06 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Rod. BR 101, s/n Km 156.5
Porto Belo, SC - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br
© Angeloni. Todos os direitos reservados | Mapa do Site

Eltr **ANGELONI**

Televendas: (48) 4002 6060

Eletrdomésticos Eletrônicos Smartphones Eletroportáteis Esporte e Lazer Cama e Banho Utilidades Domésticas Decoração Todos os Departamentos

Telefone com Fio Intelbras Pleno com Chave Preto (Objeto do produto: 1364969)

0.0 (0) Quero avaliar este produto



De: R\$ 49,90 por:

R\$ 32,90 à vista

Cor:



Quantidade:

1

Frete e prazo
Não sei o CEP

OK

Confira as formas de pagamento

Saiba mais sobre a política de troca

Informações do produto

Características

Avaliações dos clientes

COMPRAR

LISTA DE PRESENTES




036 fl

Telefone Intelbras Pleno 4080055

🌟🌟🌟🌟🌟 produto ainda sem avaliação. Deixe a Sua Opinião

Selecione a opção:

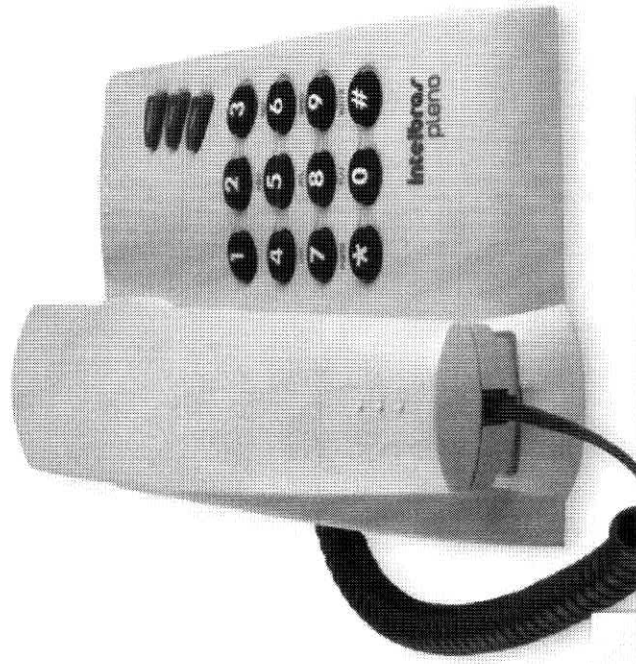

De: R\$ 40,90 por

R\$ 35,90

Ver Parcelas

ou 5x de R\$ 7,18 sem juros

Boleto Bancário R\$ 34,11 (5,0% de desconto)

COMPRAR

Frete e prazo. CEP:

Escolha a opção



037 fls

Track Info Comércio e Serviços de Inf. Ltda
CNPJ: 10.629.688/0001-27
Rua Francisco Polito, 1131 1º Andar
Vila Prudente - SP

PRO
COMPUTER

Contato  E-mail

Digite o que você procura



SAC   Vendas

Meus pedidos 

Bem vindo,
Faça seu login 

HD'S E GAVETAS

MASTERCHIEF

AUTOMOTIVO

COMPUTADORES

SERVIDORES

INFORMATICA

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Home / Ti você / Telefones com fio / Telefones com fio intelbras icon 4080051 pleno preto



Cia! Envie sua

Código: A11342-70

Telefones com fio intelbras icon 4080051 pleno preto


Disponibilidade: 7 dias

R\$ 39,57

12x de R\$ 3,62 no cartão


Outras formas de pagamentos

COMPRAR

038 

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA
 Relação das Coletas de Preços (Geral)

| Nº Coleta | Data Coleta | Validade | Item | Fornecedor | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total | Venceu |
|--|-------------|------------|------|--|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| <u>Material:</u> 3790241 - telefone com fio - preto | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 100 | 32,90 | 3.290,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 100 | 32,80 | 3.280,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 100 | 35,90 | 3.590,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 100 | 39,57 | 3.957,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 100 | 32,80 | 3.280,00 | Sim *** |
| | | | | | | | Preço Médio --> | 34,794 | 3.479,40 |
| <u>Material:</u> 3790224 - inalador hospitalar de 4 saídas | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 2 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4 | 2.020,00 | 8.080,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 2 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 4 | 1.294,85 | 5.179,40 | Sim *** |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 2 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 4 | 1.468,50 | 5.874,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 2 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 4 | 1.749,90 | 6.999,60 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 2 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 4 | 1.803,00 | 7.212,00 | Não |
| | | | | | | | Preço Médio --> | 1.667,25 | 6.669,00 |
| <u>Material:</u> 3790237 - armário de cabeceira de cama | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 3 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 50 | 838,72 | 41.936,00 | Sim *** |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 3 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 50 | 850,00 | 42.500,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 3 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 50 | 950,20 | 47.510,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 3 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 50 | 1.249,80 | 62.490,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 3 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 50 | 1.138,15 | 56.907,50 | Não |
| | | | | | | | Preço Médio --> | 1.005,374 | 50.268,70 |
| <u>Material:</u> 3790230 - carro container em fiberrglass | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 4 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 | 1.526,18 | 3.052,36 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 4 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 2 | 1.604,25 | 3.208,50 | Não |

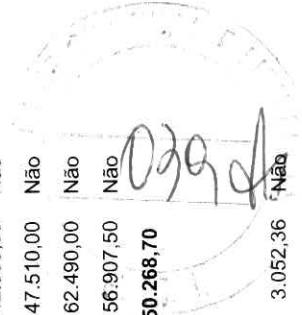


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA
Relação das Coletas de Preços (Geral)

| Nº Coleta | Data Coleta | Validade | Item | Fornecedor | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total | Venceu |
|---|-------------|------------|------|--|-------|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 4 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 2 | 1.673,60 | 3.347,20 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 4 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2 | 1.809,20 | 3.618,40 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 4 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 2 | 475,80 | 951,60 | Sim *** |
| | | | | | | Preço Médio --> | 1.417,806 | 2.835,61 | |
| <u>Material:</u> 2130220 - Monitor Multiparametro: | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 5 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 | 18.546,60 | 37.093,20 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 5 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 2 | 18.546,60 | 37.093,20 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 5 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 2 | 19.100,00 | 38.200,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 5 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2 | 9.800,00 | 19.600,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 5 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 2 | 7.699,75 | 15.399,50 | Sim *** |
| | | | | | | Preço Médio --> | 14.738,59 | 29.477,18 | |
| <u>Material:</u> 3790232 - banqueta hospitalar | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 6 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4 | 684,00 | 2.736,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 6 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 4 | 395,25 | 1.581,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 6 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 4 | 360,15 | 1.440,60 | Sim *** |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 6 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 4 | 489,50 | 1.958,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 6 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 4 | 470,65 | 1.882,60 | Não |
| | | | | | | Preço Médio --> | 479,91 | 1.919,64 | |
| <u>Material:</u> 3790227 - carrinho de emergência | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 7 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5 | 2.193,30 | 10.966,50 | Sim *** |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 7 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 5 | 2.879,50 | 14.397,50 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 7 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 5 | 2.798,00 | 13.990,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 7 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 5 | 4.400,00 | 22.000,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 7 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 5 | 5.749,00 | 28.745,00 | Não |
| | | | | | | Preço Médio --> | 3.603,96 | 18.019,80 | |

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA
 Relação das Coletas de Preços (Geral)

| Nº Coleta | Data Coleta | Validade | Item | Fornecedor | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Total | Venceu |
|--|-------------|------------|------|--|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Material: <u>3790226 - foco cirurgico de teto</u> | | | | | | | | | |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 8 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1 | 17.160,00 | 17.160,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 8 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 1 | 41.860,00 | 41.860,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 8 | MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI | | 1 | 37.800,00 | 37.800,00 | Não |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 8 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1 | 17.160,00 | 17.160,00 | Sim *** |
| 560/2019 | 04/11/2019 | 04/12/2019 | 8 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | 1 | 19.216,00 | 19.216,00 | Não |
| | | | | | | | Preço Médio --> | 26.639,20 | 26.639,20 |
| | | | | | | | Total Preço Médio --> | 49.586,884 | 139.308,53 |

Handwritten signature and circular stamp in the top right corner of the page.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariaíva, 04 de novembro de 2019.

Ref: Protocolo Nº 12231-2019


À

Secretaria de Planejamento


SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO

Solicito Bloqueio/indicação de conta para fins de abertura de Procedimento Licitatório na Modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a Aquisição de material hospitalar, remanescente do Protocolo 10952292000/1170-05 e 10952292000/1150-01 do FNS.

| |
|--|
| Valor (R\$) |
| 139.308,53 (cento e trinta e nove mil, trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos) – SEMUS |
| TOTAL R\$ 139.308,53 |


Mauricio Fernandes

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguaraiáva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguaraiava.pr.gov.br

Departamento de Compras e Licitações

Jaguaraiáva/PR, 24 de janeiro de 2020.



Ao

Departamento de Compras e Licitações

Considerando o requerimento contido nos autos e para fins de prosseguimento do processo licitatório, indicamos a seguinte fonte:

Fonte: 230

Prossiga-se na forma da Lei.

Att.

NARA GISELLE BUENO
Secretária Municipal de Planejamento








ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

Página: 1/1

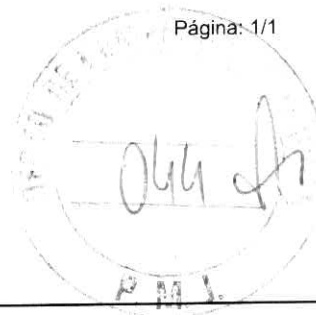

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.


Processo Administrativo: 17/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: Menor Preço
Forma de Pagamento: Conforme edital
razo de Entrega: 10 após o envio da AF
Local de Entrega: Almoxarifado SEMUS
Vigência: 10
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos remanescente das Propostas 10952292000/1170-05 e 10952292000/1150-01 FNS.
Observações:
Convidados:

Itens

| Item | Quantidade | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 4,000 | UNI | inalador hospitalar de 4 saídas | R\$ 1.667,2500 | R\$ 6.669,00 |
| 2 | 1,000 | UNI | foco cirurgico de teto | R\$ 26.639,2000 | R\$ 26.639,20 |
| 3 | 5,000 | UNI | carrinho de emergência | R\$ 3.603,9600 | R\$ 18.019,80 |
| 4 | 2,000 | UNI | carro container em fiberrglass | R\$ 1.417,8060 | R\$ 2.835,61 |
| 5 | 4,000 | UNI | banqueta hospitalar | R\$ 479,9100 | R\$ 1.919,64 |
| 6 | 50,000 | UNI | armário de cabeceira de cama | R\$ 1.005,3740 | R\$ 50.268,70 |
| 7 | 2,000 | UNI | Monitor Multiparametro; | R\$ 14.738,5900 | R\$ 29.477,18 |
| 8 | 100,000 | UNI | telefone com fio - preto | R\$ 34,7940 | R\$ 3.479,40 |
| Valor total dos itens: | | | | | R\$ 139.308,53 |

Jaguariaíva, 30 de Janeiro de 2020

Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 942
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO DECRETO n.º 587/2019

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor JOSÉ SLOBODA, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, incisos X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n.º 2661/2017,

DECRETA

Artigo 1.º. EXONERA, do cargo em provimento comissionado de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS GERAIS, nomeado que fora, através do Decreto n.º 114/2019, o Senhor ÉLIO ZUB JUNIOR, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º XX.XXX.707-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º XXX.XXX.499-77.

Artigo 2.º. NOMEIA, para o cargo em provimento comissionado de PREGOEIRO, o Senhor ÉLIO ZUB JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º X.XXX.707-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º XXX.XXX.499-77, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Abílio Russi, 261 - Bairro: Jardim Matarazzo, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo nos termos do Anexo II da Lei Municipal n.º 2661/2017.

Artigo 3.º. Fica revogado o Decreto n.º 556/2019.

Artigo 4.º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5.º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2019.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CARLOS PÉREZ GOMEZ
Secretário Municipal de Finanças

PUBLICADO
SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EM 16/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTE DAS PROPOSTAS 10952292000/1170-05 E 10952292000/1150-01 FNS. CONSTANTE DO Termo de Referência.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 18/02/2020 às 09:00 horas.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00min do dia 06/02/2020, até às 08:30 do dia 18/02/2020.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h31min às 08h59 do dia 18 de fevereiro de 2020.


INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min horas do dia 18 de fevereiro de 2020.

LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitação, 3º Andar no endereço informado abaixo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9455, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min as 17h00min.

Jaguariaíva, 30 de janeiro de 2020.

ELIO ZUB JUNIOR
Pregoeiro




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

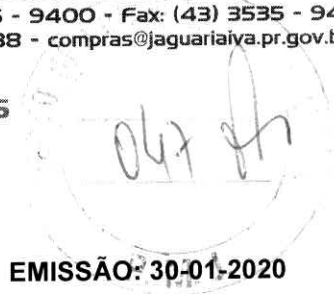

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

PROC: 17-2020

EMIÇÃO: 30-01-2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, mediante o Pregoeiro designado, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO do TIPO MENOR PREÇO – UNITÁRIO**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei e o Decreto Municipal, respectivamente nºs. 556/2019, do dia 26/09/2019 e ainda subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93.

TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 do dia 06/02/2020 até as 08:30 do dia 18/02/2020.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08:31 até 08:59 horas do dia 18/02/2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 horas do dia 18/02/2020.


REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado"

PREGOEIRO AD HOC: ELIO ZUB JUNIOR

E-MAIL: comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br

TELEFONE/FAX: (0XX43) 3535-9455.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTE DAS PROPOSTAS 10952292000/1170-05 E 10952292000/1150-01 FNS, CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | UND | ESPECIFICAÇÃO / APRESENTAÇÃO | QUANT. | VALOR ITEM MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |
|------|-----|---|--------|------------------|-------------------|
| 1 | UND | <p>inalador hospitalar de 4 saídas - Compressor utilizado para produção de ar comprimido, deverá ser isento de óleo ou impurezas. Equipamento com registro na ANVISA, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 : 2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2 : 2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6 : 2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9 : 2010 Marcação CE (Comunidade Européia) Possuir a seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão de alimentação: 127 ou 220Vac;• Cabo de alimentação com plug de 3 pinos (com pino de aterramento);• Frequência de rede: 50 ou 60 Hz;• Potência do motor: 1/4 de CV;• Interruptor liga / desliga, localizado no corpo do aparelho;• Sistema de proteção, com rearme automático, para super aquecimento do motor;• Sistema de exaustão forçada de ar do motor.• Fluxo de ar: 0 a 70 Litros/minuto• Compressão máxima: 40 lbf/pol²• Carenagem Plástica de alta resistência.• Base: pés antiderrapantes de borracha com sistema de ventosas. <p>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Dimensões Externas (Sem Suporte) Largura 18,6 cm Altura 28,6 cm Comprimento 21,3 cm • Peso líquido: 5,4 Kg</p> <p>ACOMPANHAR</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 Conjuntos micronebulizador com máscara senso 04 unidades adulto e 04 unidades infantil, extensão e copinho para medicamentos• Régua com quatro saídas com válvulas.• Micro filtro | 4 | R\$ 1667,25 | R\$ 6.669,00 |
| 2 | UND | <p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO Foco Cirúrgico Teto Simples. Deverá ser composto por uma cúpula com sistema de iluminação na tecnologia LED. A estrutura dos braços, base, eixo, garfo e antebraço deverão ser em aço, com pintura epóxi. A cúpula deverá possuir formato circular, ser simétrica e fabricada em Fibra de Vidro antichama e gel-coat ou outro polímero de mesma resistência. A cúpula principal deverá possuir: potência luminosa aproximada de 160.000 Lux (+/-2%); diâmetro Máximo da cúpula de 595 mm; quantidade mínima de 4 (Quatro) bulbos/placas de LED/ conjuntos de LEDs brancos; e a quantidade mínima de 82 (oitenta e dois) LEDs na sua composição. A potência luminosa total aproximada do equipamento deverá ser de: 160.000 Lux (+/-2%) aferido a 1 (um) metro e distância da cúpula. Índice de reprodução de cor (RA), 95 ±3. Com sistema de focalização mecânico tipo multifocal. A Temperatura de Cor Fixa deverá ser fixa em 5.000 Kelvin (+/-2%). A iluminação gerada pelos LEDs deverá ser fixa sem variação da temperatura de cor, possuindo apenas LEDs brancos na sua constituição, proporcionando maior estabilidade cromática do local iluminado; A vida útil estimada dos LEDs deverá ser de pelo menos 75.000 horas. A cúpula deverá possuir ajuste manual do campo luminoso através da manopla de focalização em alumínio localizada no centro da cúpulas, a qual deverá ser removíveis sem o uso de ferramentas e Autoclaváveis. O diâmetro do campo luminoso mínimo oferecido por cada da cúpula deverá ser de pelo menos 100 mm (+/-2%) e o diâmetro Máximo oferecido deverá ser de pelo menos 355 mm (+/-2%). A cúpula deverá possuir sistema de iluminação especial para cirurgias minimamente invasivas, também chamado de Modo Endo ou Luz Ambiente, o qual deverá estar localizado no centro de da cúpula. O sistema deverá ter acionamento individualizado no painel de comando do equipamento. O foco cirúrgico deverá possuir os seus comandos, através de painel de membrana, individual por cúpula, sendo eles: Liga/Desliga, Modo Endo e Dimmer (com pelo menos 9 níveis de intensidade de potência luminosa, o qual deverá proporcionar o ajuste da intensidade luminosa de 10% a 100% potência da Cúpula). Os comandos deverão estar localizados na própria estrutura do foco cirúrgico, sem a necessidade de instalação de comandos e controles acessórios na parede do centro cirúrgico. O(s) painel(is) de comando devera(ão) estar protegidos por painel de membrana de fácil higienização O Foco Cirúrgico deverá proporcionar coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula; Tensão (v): 110 v-220V; Frequência (Hz): 50hz/60hz. Os bulbos deverão estar isolados dentro da cúpula, com proteção em acrílico. Os braços deverão apresentar movimentação leve e precisa, sem o uso de contrapesos. O sistema de alimentação através de fonte chaveada, garantindo maior estabilidade ao funcionamento do equipamento. Informações complementares: Equipamento enquadrado às Normas Técnicas NBR IEC 60.601-1/1994 + Emenda 01/1997 e NBR IEC 60.601-1-2. Empresa Certificada de acordo com a NBR. Deverá possuir assistência técnica no Estado,..... O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde;</p> | 1 | R\$ 26.639,20 | R\$ 26.639,20 |



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| | | Garantia de 12 (meses) contra defeitos de fabricação. No valor apresentado deverá estar contemplado o frete, instalação e o treinamento da equipe de usuários do equipamento. | | | |
|---|-----|---|-----|--------------------|-----------------------|
| 3 | UND | CARRINHO DE EMERGÊNCIA Confeccionado em estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1.20mm e tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – 430AISI Acompanhar os seguintes: 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisórias em acrílico; Sistema de lacre único para as 04 gavetas; Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador; Suporte para cilindro de O2; Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de 800mm de comprimento; Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T); Tábua para massagem cardíaca em madeira MDF; Chassi com proteção de borracha em toda a volta; Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal Possuir acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Dimensão aproximada de 700 x 500 x 800 mm e registro MS | 5 | R\$ 3.603,96 | R\$ 18.019,80 |
| 4 | UND | CARRO CONTAINER EM FIBERGLASS COM TAMPA - 630 LITROS Modelo idealizado visando melhor ergonomia no transporte de materiais que requerem maior esforço do operador; O Carro deve possuir Porta Lateral e Sistema de Freios é confeccionado em fiberglass de alta durabilidade e resistência, com acabamento em gel coat isoftálico, liso interna e externamente. Possui dreno para escoamento de líquidos. Dispositivo de elevação e suporte da tampa, por sistema pneumático que reduz o impacto da tampa superior e proporciona leveza na sua abertura. Modelo com tampa. Possibilita fácil higienização. Pneus: maciços, diâmetro 06", que apresentam boa absorção de choques e eliminação de ruídos, ou seja, a mesma performance dos infláveis: leves, silenciosos e macios, sem a necessidade de enchê-los. Banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Sistema de Freios para o Condutor: composto de sistema manual de freios, o qual permite melhor controle do carro em rampas de descida, com duplo acionamento acoplados no puxador, que é confeccionado em aço inoxidável. Com sistema de proteção anti-impactos laterais e frontais. | 2 | R\$ 1.417,8006 | R\$ 2.835,61 |
| 5 | UND | BANQUETA HOSPITALAR Confeccionado em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304. Possuir assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura - AISI430, assento com 350mm de diâmetro, arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304, altura regulável através de eixo vertical roscaado em aço zincado e 04 pés com ponteiros plásticos. Dimensão de 350 mm - Altura Máxima de 700 mm e capacidade de até 110Kg | 4 | R\$ 479,91 | R\$ 1.919,64 |
| 6 | UND | ARMARIO DE CABECEIRA DE CAMA Confeccionado em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura, tampo de refeição em tubo de aço cromado e acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso Acompanhar tampo da mesa e de refeição em MDF c/ revestimento em laminado decorativo Possuir 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço; Tampo de refeição com regulagem de altura; Puxadores em material de aço carbono; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Dimensão de: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima de 1230 mm | 50 | R\$ 1.005,3740 | R\$ 50.268,70 |
| 7 | UND | Monitor Multiparametro; Descrição: Deve fornecer dados vitais do paciente de forma precisa, rápida e fácil de analisar, com excelente visibilidade das informações e flexibilidade de parâmetros ECG - Respiração - Oximetria - Pressão Não Invasiva - 2 Temp - 2 Pl, Módulo de CapnografiaMain/SideStream, tela TFT LCD colorida de alta resolução de 10 a 12, análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso, bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade, memória interna para 128 horas de armazenamento de dados, pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos, alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis, conexão com central monitorização via cabo ou wireless, alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme, suporte para fixação em macas integrado na alça, congelamento de imagem e cálculo de drogas. Marca similar ou superior: BM5 Bionet | 2 | R\$ 14.738,59 | R\$ 29.477,18 |
| 8 | UND | Telefone Com Fio - Preto Resistente, prático e fácil limpeza. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar), pode ser instalado na parede, possui fio longo para comunicação. | 100 | R\$ 34,7940 | R\$ 3.479,40 |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 139.308,53 |

Documentação: a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.


Forma de pagamento: O pagamento será realizado no prazo de até 30 dias após entrega do objeto, através de protocolo de pedido de pagamento, juntamente com os documentos de recebimento/aceite do produto assinado pelo fiscal de recebimento, e ainda os seguintes documentos: FGTS, Federal e Certidão Municipal.

* **Prazo máximo para entrega:** até 07 (sete) dias do recebimento da nota de empenho.

Local de entrega:

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – Estado do Paraná

Endereço: Praça Isabel Branco, nº 142 – bairro Cidade Alta




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

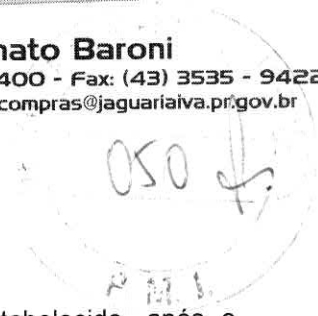

DAS ENTREGAS

As entregas serão conforme a necessidade da SEMUS, conforme cronograma estabelecido, após o resultado da licitação, respeitando **datas, quantidades determinadas**.

Ainda em conformidade com a Recomendação Administrativa n.º 01/2019 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, o qual **RECOMENDA** aos Prefeitos dos Municípios Paranaenses que orientem os servidores das repartições a eles subordinadas quando do recebimento de medicamentos e produtos farmacêuticos no sentido de **exigirem** dos respectivos fornecedores o adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.

Para tanto, na elaboração dos editais de licitação, impõe-se prever **obrigatoriedade** de o fornecedor comprove, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e, modelo 55.

As pessoas responsáveis pelas entregas nas deverão efetuá-las no horário de expediente (das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 h, respeitando o intervalo para almoço).

O atraso de datas das entregas, alterações de quantidades, e produtos que não atendam os padrões de qualidade implicarão em multa, caso a empresa não cumpra com as solicitações para substituição das mercadorias num prazo de 24 horas conforme declaração do proponente;

DO REAJUSTE:

Os preços constantes na proposta apresentada somente poderão ser alterados após 60 (sessenta) dias de vigência dos contratos, mediante comprovação de alta de mercado através de apresentação de Notas Fiscais e matérias de notoriedade (dados jornalísticos).

Recursos Financeiros: Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Código Reduzido 230

Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO 02 - HABILITAÇÃO

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA (caso venha a ser vencedora, apresentar juntamente com a proposta corrigida (anexo 01))


ANEXO 04 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL (A e B)

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP.

ANEXO 07 – MINUTA DO CONTRATO

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do **Sistema de Pregão na Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário designado da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, **denominado Pregoeiro**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** (www.bll.org.br).

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão Eletrônico neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam nos seguintes termos:

4.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;


4.2 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

4.3 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

a) **Instrumento particular de mandato** outorgando à corretora associada / interveniente, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela **Bolsa de licitações e Leilões do Brasil (ANEXO 04)**

b) **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (ANEXO 04)** e;

c) **Proposta de Preços**, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade com os **ANEXO 01 e 03**. **Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. "A empresa participante do certame não deve ser identificada"**.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate conforme o Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

5.2. Credenciamento no Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL:

5.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6. "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

5.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** corretora contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

053

5.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.

5.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3. Participação:

5.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

5.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

5.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através de através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** ou pelo e-mail contato@bll.org.br.


5.4. Abertura Das Propostas E Formulação Dos Lances:

5.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

5.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5.4.5. **Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE/PRODUTO). O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante.**

5.4.6. **Ficará a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.**

5.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes.

5.4.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

5.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

5.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances **(FECHAMENTO RANDÔMICO)**.


5.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

5.4.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

5.4.13. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

5.5. Referente a Habilitação:

5.5.1. **Os documentos relativos à habilitação solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 7), os quais deverão ser remetidos preferencialmente via e-mail (comprasiag@gmail.com), no prazo máximo de 02 horas**, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observando os prazos legais pertinentes.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

055 97

5.5.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser **OBRIGATORIAMENTE** encaminhados, **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, contados da data da sessão pública virtual, **juntamente com a proposta de preços corrigida**, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco – 142, bairro Cidade Alta, Jaguariaíva - PR

A/C Pregoeiro: ELIO ZUB JUNIOR

5.5.3. A sessão pública ficará suspensa até o recebimento da documentação original (habilitação), dentro das condições dispostas no item acima.

5.5.4. **O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos acima estabelecidos, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente** para apresentação de sua Habilitação.

5.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

5.5.6. Caso não sejam apresentados lances será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, ou ser declarada FRACASSADA a licitação.

5.5.7. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.


5.5.8. **Quando for constatado o empate, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, o sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.**

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão **obrigatoriamente** ser informadas no campo próprio as **ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E MODELOS** dos serviços/ produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do serviço/ produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos serviços/produtos neste campo, implicará na **desclassificação** da Empresa, face à ausência de informação suficiente para análise da proposta

6.3. **O objeto** deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas no **ANEXO 01**.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

6.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

6.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 07) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

6.6. As propostas deverão ser formuladas em formato texto (Word), planilha (Excel) e Adobe Reader 9.0, para Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000. As propostas cadastradas e que não puderem ser “abertas” pelo Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000 e posteriormente lidas e analisadas serão desclassificadas.

7. PROPOSTA ESCRITA:

7.1. A Empresa vencedora deverá enviar **no prazo estipulado no item 5.5.2.** ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o (último valor ofertado, conforme modelo anexo a este edital.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

8.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**, observando as condições definidas neste Edital.

8.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**.


8.3. Em atendimento ao disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes procedimentos:

8.3.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitarias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.30, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea “a” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

8.3.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 4.2.30, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

8.3.3. O sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.3.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.3.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.2.27 e 7.2.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

8.3.6. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9. HABILITAÇÃO: Conforme ANEXO 02.

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:

10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou **solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.**

10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.

10.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, **através do seu representante**, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.5. **A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.**

10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro **não** terão efeito suspensivo.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

As impugnações ou recursos deverão ser enviados da seguinte forma:

- **Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de JAGUARIAIVA, no endereço: Praça Isabel Branco, 142 setor de protocolo, andar térreo - direcionada ao Departamento**



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

058

de Compras e Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.

• Uma via deverá ser encaminhada por e-mail (comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.


11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. A CONTRATADA se sujeitará, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal:

- Advertência;
 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
 - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
 - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
 - A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
 - licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ainda, ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal nº 8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.
- 11.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autarquia revogá-la no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Autarquia Municipal poderá ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

12.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

12.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

12.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

12.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

12.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

12.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

12.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

12.10. Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

12.11. Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários, **no prazo máximo de até 02 dias úteis antes da abertura do Pregão**, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, sito a Praça Isabel Branco, 142 ou ainda pelo telefone: (43) 3535-9455, no horário das 08h00m às 17h30m, de segunda a sexta-feira, ou mesmo pelo e-mail: comprasiag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br

12.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

12.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

12.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

12.15 - Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa vencedora será notificada que poderá ser chamada a contratar com o município, e se isso ocorrer, terá o prazo de 5 dias para comparecer a prefeitura e assinar o contrato, sob pena de não fazendo ser desclassificada e ainda declarada inidônea para contratar com a administração pública.

Jaguariaíva, 30 de janeiro de 2020.

ELIO ZUB JUNIOR
PREGOEIRO



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTE DAS PROPOSTAS 10952292000/1170-05 E 10952292000/1150-01 FNS, CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | UND | ESPECIFICAÇÃO / APRESENTAÇÃO | QUANT. | VALOR ITEM MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |
|------|-----|---|--------|------------------|-------------------|
| 1 | UND | <p>inalador hospitalar de 4 saídas - Compressor utilizado para produção de ar comprimido, deverá ser isento de óleo ou impurezas. Equipamento com registro na ANVISA, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 : 2010 + Amd. 1 IEC (2012) ABNT NBR IEC 60601-1-2 : 2010 ABNT NBR IEC 60601-1-6 : 2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9 : 2010 Marcação CE (Comunidade Européia) Possuir a seguintes informações: • Tensão de alimentação: 127 ou 220Vac; • Cabo de alimentação com plug de 3 pinos (com pino de aterramento); • Frequência de rede: 50 ou 60 Hz; • Potência do motor: 1/4 de CV; • Interruptor liga / desliga, localizado no corpo do aparelho; • Sistema de proteção, com rearme automático, para super aquecimento do motor; • Sistema de exaustão forçada de ar do motor. • Fluxo de ar: 0 a 70 Litros/minuto • Compressão máxima: 40 lbf/pol² • Carenagem Plástica de alta resistência. • Base: pés antiderrapantes de borracha com sistema de ventosas. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Dimensões Externas (Sem Suporte) Largura 18,6 cm Altura 28,6 cm Comprimento 21,3 cm • Peso líquido: 5,4 Kg ACOMPANHAR • 04 Conjuntos micronebulizador com máscara senso 04 unidades adulto e 04 unidades infantil, extensão e copinho para medicamentos • Régua com quatro saídas com válvulas. • Micro filtro</p> | 4 | R\$ 1667,25 | R\$ 6.669,00 |
| 2 | UND | <p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO Foco Cirúrgico Teto Simples. Deverá ser composto por uma cúpula com sistema de iluminação na tecnologia LED. A estrutura dos braços, base, eixo, garfo e antebraço deverão ser em aço, com pintura epóxi. A cúpula deverá possuir formato circular, ser simétrica e fabricada em Fibra de Vidro antichama e gel-coat ou outro polímero de mesma resistência. A cúpula principal deverá possuir: potência luminosa aproximada de 160.000 Lux (+/-2%); diâmetro Máximo da cúpula de 595 mm; quantidade mínima de 4 (Quatro) bulbos/placas de LED/ conjuntos de LEDs brancos; e a quantidade mínima de 82 (oitenta e dois) LEDs na sua composição. A potência luminosa total aproximada do equipamento deverá ser de: 160.000 Lux (+/-2%) aferido a 1 (um) metro e distância da cúpula. Índice de reprodução de cor (RA): 95 ±3. Com sistema de focalização mecânico tipo multifocal. A Temperatura de Cor Fixa deverá ser fixa em 5.000 Kelvin (+/-2%). A iluminação gerada pelos LEDs deverá ser fixa sem variação da temperatura de cor, possuindo apenas LEDs brancos na sua constituição, proporcionando maior estabilidade cromática do local iluminado; A vida útil estimada dos LEDs deverá ser de pelo menos 75.000 horas. A cúpula deverá possuir ajuste manual do campo luminoso através da manopla de focalização em alumínio localizada no centro da cúpulas, a qual deverá ser removíveis sem o uso de ferramentas e Autoclaváveis. O diâmetro do campo luminoso mínimo oferecido por cada da cúpula deverá ser de pelo menos 100 mm (+/-2%) e o diâmetro Máximo oferecido deverá ser de pelo menos 355 mm (+/-2%). A cúpula deverá possuir sistema de iluminação especial para cirurgias minimamente invasivas, também chamado de Modo Endo ou Luz Ambiente, o qual deverá estar localizado no centro de da cúpula. O sistema deverá ter acionamento individualizado no painel de comando do equipamento. O foco cirúrgico deverá possuir os seus comandos, através de painel de membrana, individual por cúpula, sendo eles: Liga/Desliga, Modo Endo e Dimmer (com pelo menos 9 níveis de intensidade de potência luminosa, o qual deverá proporcionar o ajuste da intensidade luminosa de 10% a 100% potência da Cúpula). Os comandos deverão estar localizados na própria estrutura do foco cirúrgico, sem a necessidade de instalação de comandos e controles acessórios na parede do centro cirúrgico. O(s) painel(is) de comando deverá(ão) estar</p> | 1 | R\$ 26.639,20 | R\$ 26.639,20 |



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| | | | | | | |
|---|-----|--|-----|--------------------|-----------------------|--|
| | | <p>protegidos por painel de membrana de fácil higienização</p> <p>O Foco Cirúrgico deverá proporcionar coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula; Tensão (v): 110 v-220V; Frequência (Hz): 50hz/60hz. Os bulbos deverão estar isolados dentro da cúpula, com proteção em acrílico. Os braços deverão apresentar movimentação leve e precisa, sem o uso de contrapesos.</p> <p>O sistema de alimentação através de fonte chaveada, garantindo maior estabilidade ao funcionamento do equipamento.</p> <p>Informações complementares: Equipamento enquadrado às Normas Técnicas NBR IEC 60 601-1/1994 + Emenda 01/1997 e NBR IEC 60.601-1-2. Empresa Certificada de acordo com a NBR. Deverá possuir assistência técnica no Estado. O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde; Garantia de 12 (meses) contra defeitos de fabricação. No valor apresentado deverá estar contemplado o frete, instalação e o treinamento da equipe de usuários do equipamento.</p> | | | | |
| 3 | UND | <p>CARRINHO DE EMERGÊNCIA</p> <p>Confeccionado em estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1 20mm e tampo em chapa de aço inox de 0 80mm de espessura – 430AISI</p> <p>Acompanhar os seguintes: 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisórias em acrílico; Sistema de lacre único para as 04 gavetas; Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador; Suporte para cilindro de O2; Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de 800mm de comprimento; Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T); Tábua para massagem cardíaca em madeira MDF; Chassi com proteção de borracha em toda a volta; Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal</p> <p>Possuir acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensão aproximada de 700 x 500 x 800 mm e registro MS</p> | 5 | R\$ 3.603,96 | R\$ 18.019,80 | |
| 4 | UND | <p>CARRO CONTAINER EM FIBERGLASS COM TAMPA - 630 LITROS</p> <p>Modelo idealizado visando melhor ergonomia no transporte de materiais que requerem maior esforço do operador.</p> <p>O Carro deve possuir Porta Lateral e Sistema de Freios é confeccionado em fiberglass de alta durabilidade e resistência, com acabamento em gel coat isofáltico, liso interna e externamente. Possui dreno para escoamento de líquidos. Dispositivo de elevação e suporte da tampa, por sistema pneumático que reduz o impacto da tampa superior e proporciona leveza na sua abertura. Modelo com tampa. Possibilita fácil higienização.</p> <p>Pneus: maciços, diâmetro 06", que apresentam boa absorção de choques e eliminação de ruídos, ou seja, a mesma performance dos infláveis: leves, silenciosos e macios, sem a necessidade de enchê-los. Banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado.</p> <p>Sistema de Freios para o Condutor: composto de sistema manual de freios, o qual permite melhor controle do carro em rampas de descida, com duplo acionamento acoplados no puxador, que é confeccionado em aço inoxidável.</p> <p>Com sistema de proteção anti-impactos laterais e frontais.</p> | 2 | R\$ 1.417,8006 | R\$ 2.835,61 | |
| 5 | UND | <p>BANQUETA HOSPITALAR</p> <p>Confeccionado em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1 20mm – AISI304</p> <p>Possuir assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura - AISI430, assento com 350mm de diâmetro, arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1 20mm – AISI304, altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado e 04 pés com ponteiros plásticos. Dimensão de 350 mm - Altura Máxima de 700 mm e capacidade de até 110Kg</p> | 4 | R\$ 479,91 | R\$ 1.919,64 | |
| 6 | UND | <p>ARMÁRIO DE CABECEIRA DE CAMA</p> <p>Confeccionado em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura, tampo de refeição em tubo de aço cromado e acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso</p> <p>Acompanhar tampo da mesa e de refeição em MDF c/ revestimento em laminado decorativo</p> <p>Possuir 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço; Tampo de refeição com regulagem de altura; Puxadores em material de aço carbono; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro</p> <p>Dimensão de: 510 x 400 x 800 mm - Altura Máxima de 1230 mm</p> | 50 | R\$ 1.005,3740 | R\$ 50.268,70 | |
| 7 | UND | <p>Monitor Multiparametro;</p> <p>Descrição: Deve fornecer dados vitais do paciente de forma precisa, rápida e fácil de analisar, com excelente visibilidade das informações e flexibilidade de parâmetros ECG - Respiração - Oximetria - Pressão Não Invasiva - 2 Temp - 2 PI, Módulo de CapnografiaMain/SideStream, tela TFT LCD colorida de alta resolução de 10 a 12, análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso, bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade, memória interna para 128 horas de armazenamento de dados, pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos, alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis, conexão com central monitorização via cabo ou wireless, alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme, suporte para fixação em macas integrado na alça, congelamento de imagem e cálculo de drogas.</p> <p>Marca similar ou superior: BM5 Bionet</p> | 2 | R\$ 14.738,59 | R\$ 29.477,18 | |
| 8 | UND | <p>Telefone Com Fio - Preto</p> <p>Resistente, prático e fácil limpeza. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar), pode ser instalado na parede, possui fio longo para comunicação.</p> | 100 | R\$ 34,7940 | R\$ 3.479,40 | |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 139.308,53 | |

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 139.308,53 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DAS ENTREGAS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- a) – A empresa vencedora deverá providenciar a entrega dos veículos na **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná**, situado na Praça Isabel Branco, nº 142, Cidade Alta.
- b) – **Horário para entrega: 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:00hs. Não será recebido nenhum produto fora desses horários.**
- c) – Os produtos serão entregues da seguinte forma:
- d) O prazo de entrega será de 07 (sete) dias úteis de acordo com os pedidos estipulados pela secretaria;
- e) As entregas deverão ser efetuadas pela empresa vencedora, com frete por conta e risco do fornecedor;
- f) **O recebimento do material hospitalar será inicialmente em caráter provisório, o aceite definitivo dar-se-á com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, e está condicionada ao atendimento das exigências contidas no Edital de Licitação. Caso não cumpra as exigências deste Edital o Fornecedor será comunicado a retirar o produto no local de entrega e a substituí-lo por outro que atenda as especificações contidas no Anexo I, sem nenhum ônus para Prefeitura Municipal.**
- g) As proponentes vencedoras do certame deverão seguir fielmente os pedidos estipulados pela secretaria solicitante, observando datas, quantidades, horário, marcas e características apresentadas no ato licitatório e na proposta de preços. As proponentes deverão garantir a assinatura do responsável pelo recebimento no ato da entrega;
- h) As Notas Fiscais devem ser emitidas no dia da entrega e vir junto com as mercadorias;
- i) As mercadorias devem ser entregues em sua totalidade, conforme Nota Fiscal, caso contrário toda mercadoria será devolvida;
- j) – Em caso de devolução do(s) produto(s), por estar(em) em desacordo com as especificações contidas no Anexo I, todas as despesas serão atribuídas a Contratada devendo providenciar no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, e sua substituição.
- k) – A Contratada, não cumprindo o prazo de reposição citado, estará sujeita as sanções previstas no item 12 deste edital.
- l) – A empresa adjudicatária deverá observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por seu descumprimento.

14.7 – A licitante vencedora, se sujeitar a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Comissão de Recebimento da Prefeitura, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações.

OBS:


* **Documentação:** a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do contrato de aquisição é de 06 (seis) meses contados da data de assinatura do contrato.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS PROPOSTAS, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos preferencialmente via e-mail (comprasjag@gmail.com) no prazo máximo de 02 horas. Após término da sessão pública. Os mesmos documentos deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida e amostra, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco, nº 142 - Jaguariaíva - PR

A/C: Pregoeiro Ad Hoc ELIO ZUB JUNIOR

9. Os documentos de habilitação a ser incluídos no Envelope 02, são constituídos de:

9.1. Habilitação Jurídica:

a) **Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial**, com as alterações realizadas ou devidamente consolidado.

9.2. Regularidade Fiscal:

a) **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.**

b) **Inscrição Estadual**, CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviços que esteja isenta da Inscrição, apresentar **Declaração de Isenção**, sob as penas da Lei.

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, através da Certidão expedida pela Secretaria de Estado da fazenda.

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, através de Certidão expedida pela Prefeitura Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).

f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/FGTS**);

g) Autorização de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.

h) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

9.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica-Financeira:

a) **Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. Se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias da emissão.

9.4. Habilitação técnica



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

a) Apresentação de **atestado de capacidade técnica**, compatível com o ramo de atividade e que comprove já ter fornecido produtos da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável.

9.5. Habilitação Complementar:

a) **Declaração conjunta** (Anexo 06)

b) **Declaração ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que se encontra enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo).**

9.6. Todos os documentos de habilitação deverão estar em **plena vigência**.

9.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais.

9.8. É facultado o Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação.

9.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.10. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da próxima classificada.


9.11. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem valer-se da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão ter apresentado no credenciamento (fora dos Envelopes nº. 01 e 02), **DECLARAÇÃO** (assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa conforme o modelo Anexo), **OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que se encontra enquadrada em uma dessas situações.

9.10.1. Se comprovado que a empresa participante realmente for EPP ou ME, e havendo alguma restrição quanto à habilitação fiscal, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar em Ata.

9.10.2. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA

(CASO VENHA A SER VENCEDORA, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CORRIGIDA)



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

Apresentamos nossa proposta corrigida do Pregão Eletrônico nº 10-2020, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO COMPLETO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA


2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 04 (A)

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES

| | |
|--|-----------|
| Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) | |
| Nome:(Razão Social) | |
| Endereço: | |
| Complemento | Bairro: |
| Cidade: | UF |
| CEP: | CNPJ/CPF: |
| Inscrição estadual: | RG |
| Telefone comercial: | Fax: |
| Celular: | E-mail: |
| Representante legal: | |
| Cargo: | Telefone: |
| Ramo de Atividade: | |


1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5. **(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras)** O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- ii. apresentar lance de preço;
- iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. apresentar e retirar documentos;
- vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. assinar documentos relativos às propostas;
- ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.


| | |
|------------|--|
| Corretora: | |
| Endereço: | |
| CNPJ: | |

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/__, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

Assinatura: _____

(reconhecer firma em cartório)



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 04 (B)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema

| | |
|----------------------------|-----------|
| Razão Social do Licitante: | |
| CNPJ/CPF: | |
| Operadores | |
| 1 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |
| 2 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |
| 3 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |

O Licitante reconhece que:

- a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

Responsável: _____

Assinatura: _____




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

(reconhecer firma em cartório)

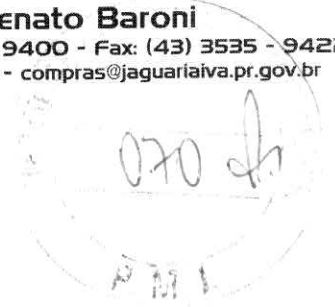

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020

EDITAL DE: _____ Nº ____/2020


DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos **declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
2. Declaramos que não existem **fatos impeditivos** para participação deste procedimento licitatório.
3. Declaramos que nos comprometemos em **substituir nos prazos previstos** os produtos que estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital.
4. Declaramos que **não possuímos**, em nosso Quadro de Pessoal, **empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
5. Declara, **que conhece todos os termos da licitação**, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que **cumpre** todos os requisitos exigidos.

Em ____ de _____ de ____

Diretor ou Representante Legal

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP PREGÃO ELETRONICO Nº 10-2020


(Nome da empresa), CNPJ / MF nº. sediada (endereço completo),

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 07

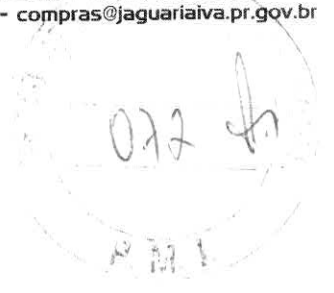

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pregão Eletrônico nº. 10-2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. .../2020

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel Branco, 142 – Cidade Alta - inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representado pelo Sr. José Sloboda, brasileiro, casado, portador do RG nº. 4336839-7-Pr, e CPF nº. 526.333.009-82, residente e domiciliado na Av. Conde Francisco Matarazzo, nesta Cidade, Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Carlos Perez Gomez, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, portador do RG nº. 7.574.174-0-SSP-PR e CPF nº. 411.911.619-00 Secretário Municipal de Finanças.

CONTRATADA:

(...), pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº. (...), com sede no Endereço (...), representado pelo (Sócio Administrador, Diretor) Sr. ou Srª (...), CIRG nº. (...), inscrito no CPF. nº. (...), residente e domiciliado na Rua (...), os contratantes estão sujeitos às normas da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL O presente contrato tem como objeto (...) o fornecimento a serem entregues pela CONTRATADA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº. 10-2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, todos os documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, vinculados ao Processo do Pregão Eletrônico nº., com suas especificações, cotações, propostas e documentos pertinentes as espécies, parecer jurídico, publicações, etc.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento da importância contida na Cláusula Quarta correrá à conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R\$ (...).

§ 1º - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2º - O pagamento será efetuado até 10 dias após o fornecimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a quantidade fornecida no período.

§ 3º - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente na entrega, após a apresentação da fatura do(s) objeto(s) fornecido(s) devidamente protocolada, desde que atendidas às condições para a liberação.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

- a) o faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias, na sede da contratante.
- b) o faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
- b.1) nota fiscal com o nome do objeto fornecido de acordo com o número do procedimento, número deste Contrato, e outros que julgar conveniente, sem apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificado pela CONTRATANTE.
- b.2) A fatura com o nome do(s) item(s) de acordo com o número do procedimento do PREGÃO ELETRÔNICO, número deste Contrato, e outros que julgar conveniente;
- b.3) Termo de recebimento atestado pela Comissão Municipal competente.
- b.4) Comprovar regularidade fiscal, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

O fornecimento será efetuado com requisições e ordens, conforme a necessidade, obedecidas as especificações contidas em cada Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE, através do departamento competente, no prazo máximo de dias a partir da ordem ou solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização por escrito, do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Fica a Contratada obrigada a fornecer garantias, às suas expensas, as alterações, substituições a qualquer produto que apresente anomalia, bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO


O contratante se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos: a) quando a Contratada falir ou for dissolvida; b) quando a Contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem a prévia anuência da Contratante; c) quando houver atraso na entrega do objeto pelo prazo superior a 10 (dez) dias, após solicitação verbal ou escrita, por parte da Contratada sem justificativa aceita, d) quando houver inadimplência de cláusula ou condições contratuais por parte do Contratado.

§ 1º - A Rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

§ 2º - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93.

§ 3º - A Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 4º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à Contratada, direito a qualquer indenização.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante Termo Aditivo, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a vigência decorrente das obrigações assumidas pelo Contratado, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas perante o Contratante.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

A vigência deste contrato é 06 (seis) meses, com o prazo de entrega até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

A publicação será até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

- a) Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento dos objetos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
- b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93.
- c) efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o artigo 71 da Lei Federal nº. 8.666/93.
- d) manter durante a vigência do presente contrato todas as obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como as determinações da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Prefeitura obriga-se a publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, conforme art.61, parágrafo único da Lei 8666/93.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, seus parágrafos e incisos.

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

13.3. Multa de 10% (dez) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.

13.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

13.5. As multas mencionadas nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 poderão ser descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

13.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas, civis ou penais, previstas na legislação brasileira.

13.7. Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública nos casos de:

- a) apresentação de documentação falsa;
- b) retardamento na execução do objeto;
- c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- d) comportamento inidôneo;
- e) fraude na execução do contrato;
- f) falha na execução do contrato.

Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo perante o foro da Comarca de Jaguariaíva/PR, não obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Jaguariaíva/PR, (...) de (...) de 2017.

CONTRATANTE


CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/RG:

Testemunhas:

CPF/RG:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariáiva, 30 de janeiro de 2020.

Protocolo 12231-2019

PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020

Processo DCL 17-2020

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTE DAS PROPOSTAS
10952292000/1170-05 E 10952292000/1150-01 FNS.
SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE**

Ilma. Douta. Procuradora,

Por meio do presente, análise do feito, ou seja, Parecer Preliminar, visando ao prosseguimento do feito.



Maurício Fernandes

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Ilma. Sra. Dra.

RENATA POMPEO DA SILVA

MD. Procuradora do Município



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariáiva – PR, 31 de janeiro de 2020.

PARECER JURÍDICO

| |
|--|
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2020 – P.E. Nº 10/2020 |
| MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO |
| SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde |
| ASSUNTO: Aquisição de equipamentos remanescentes das propostas 10952292000/1170-05 e 10952292000/1150-01 FNS |

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde objetivando a Aquisição de equipamentos remanescentes das propostas 10952292000/1170-05 e 10952292000/1150-01 FNS.

Segundo a Secretaria a aquisição é necessária para o funcionamento dos trabalhos no Hospital Municipal, conforme justificativa constante no Termo de Referência (pg 03).

Constam dos autos os seguintes documentos:

- Solicitação do interessado (pg 02);
- Termo de Referência (PG 03 a 06);
- Decreto de Nomeação da comissão responsável (pg 45);
- Parecer contábil/indicação orçamentária (pg 43);
- Cotações de Preço (pg 07 a 41);
- Autorização do Prefeito Municipal (pg 44)
- Minuta de Edital e seus anexos além da minuta do Contrato (pg 46 a 75).





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Passemos a análise jurídica.

II. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS:

A análise integral dos processos licitatórios tem como base garantir que estes adendam os dispositivos legais e estejam em consonância com os princípios que regem a Administração Pública como um todo.

Os pareceres jurídicos visam sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração pública e a análise desta Procuradoria Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos órgãos competentes e especializados da Administração Pública constantes no processo.

Assim, os documentos trazidos até esta Procuradoria tem caráter de veracidade, pois não possui a Procuradoria Jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de diligenciar sobre a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, deflagrados pelo processo licitatório.

Tal manifesto tem caráter de apoio e possui viés opinativo sobre a contratação em tela, não representando prática de ato de gestão, mas sim uma aferição técnico-jurídica que se restringe a análise dos aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador, em seu âmbito discricionário.

III. MÉRITO:

O decreto 5.450/2002 regulamentou a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, qual será realizada quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

O Pregão eletrônico tem por objetivo ampliar o alcance dos participantes e diminuir os custos, em observância ao Princípio da Eficiência. Permite, ainda, a ampliação da disputa, com a





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

participação de maior número de empresas o que garante atingir o menor preço para a Administração Pública.

O Pregão eletrônico é uma inovação legislativa que torna o processo licitatório mais ágil e transparente pois permite a simplificação das etapas burocráticas que tornavam vagarosa a contratação, facilitando os trâmites da Administração Pública e do Particular.

O artigo 9º do Decreto 5.450/2002 aponta os requisitos que devem ser observados na fase preparatória do processo licitatório, quais sejam:

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

§ 1º A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração.

§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara,



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

concisa e objetiva.

Da análise dos autos verifica-se que os requisitos indispensáveis foram devidamente cumpridos.

Ademais, estão anexas cotações de preços que comprovam a pesquisa de mercado necessária para obtenção dos valores.

A análise da minuta de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, ou seja, a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e atualizações; Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto nº 3.555/2000.

IV. CONCLUSÃO:

ANTE O EXPOSTO, o Edital do presente processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se **FAVORÁVEL** a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade.

É o Parecer,

S. M. J.


RENATA POMPEO DA SILVA

OAB/PR 65.560